
iESS
all for a smile

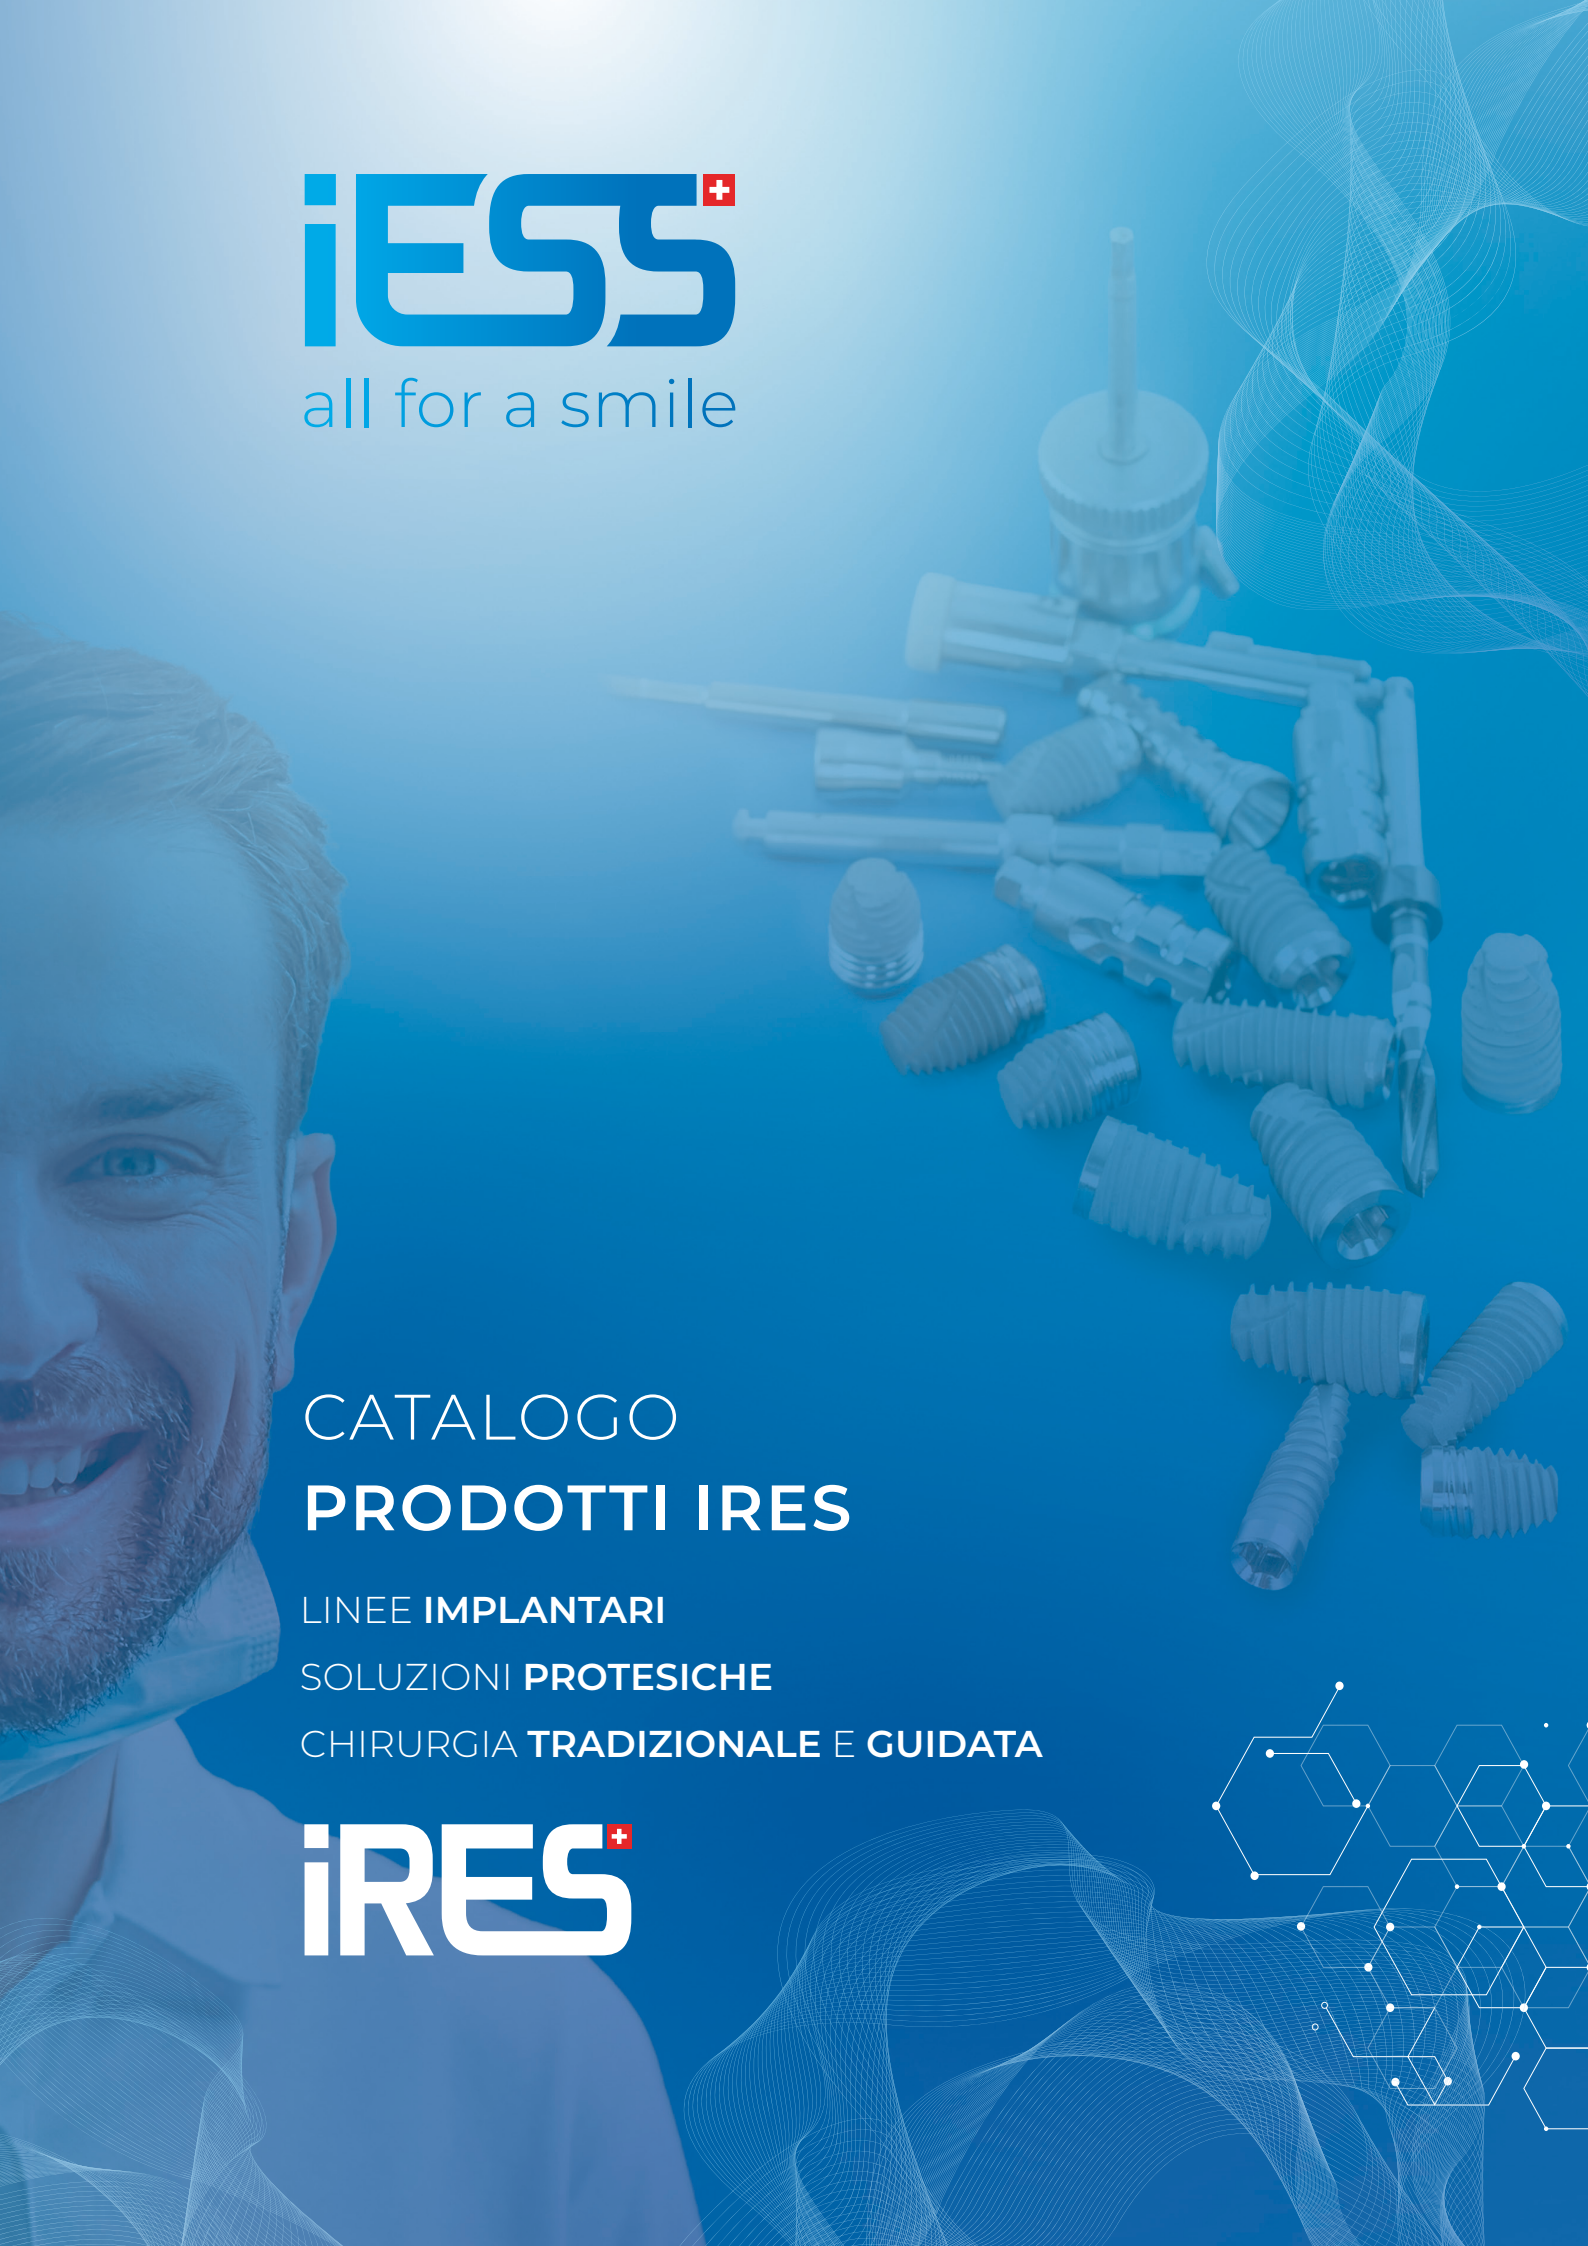

CATALOGO
PRODOTTI IRES

LINEE **IMPLANTARI**

SOLUZIONI **PROTESICHE**

CHIRURGIA **TRADIZIONALE** E **GUIDATA**

iRES



all for a smile

IESS Group è una realtà internazionale nata dalla fusione tra **Geass** e **iRES Group** nel 2021, ampliata con l'ingresso di **Multysystem** nel 2022.

geass

40 ANNI DI KNOW HOW
IN IMPLANTOLOGIA

iRES

PRODUZIONE SVIZZERA E
IMPRINTING INTERNAZIONALE

MULTY SYSTEM

ESPERIENZA
TRENTENNALE


Precisione svizzera e **innovazione italiana** si sono unite per raggiungere gli standard qualitativi più elevati e offrire un'ampia gamma di **prodotti** e **servizi**, valorizzati da esperienza ultratrentennale, **attività scientifica** ai massimi livelli ed **eccellenza** nel campo digitale.
Tutte le soluzioni sono pensate per supportare i professionisti del settore dentale nel raggiungimento di **un unico obiettivo: il sorriso**.

Ogni giorno, nelle **tre sedi in Italia e Svizzera**, ci impegniamo nella produzione di dispositivi medici standard e su misura affinché le nostre **soluzioni** siano **sicure**, **affidabili** e **all'avanguardia**.



L'implantologia costituisce le fondamenta aziendali ed è tuttora il core business del gruppo.


Una gamma che offre **numerose tipologie implantari e connessioni**, per soddisfare **ogni tipo di riabilitazione** e necessità clinica.
Fiore all'occhiello degli impianti IESS Group sono la **superficie brevettata al laser Synthegra** e l'opzione del **trattamento ibrido**, soluzioni pensate per prevenire il rischio di perimplantiti nei soggetti a rischio.

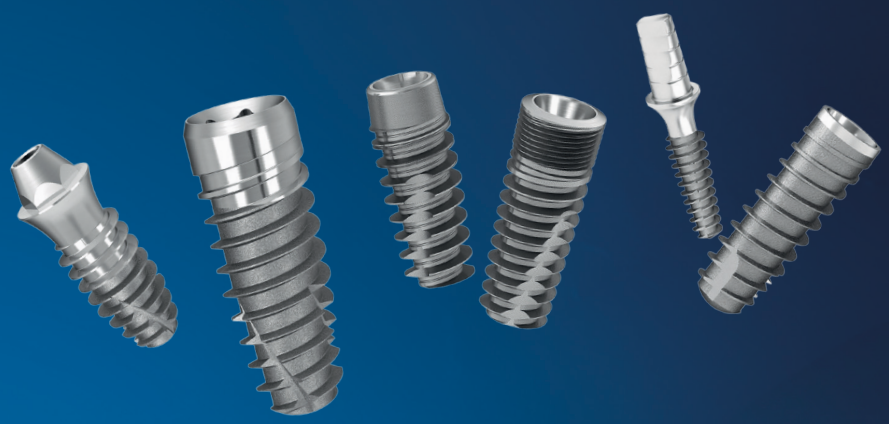

Un'intensa attività di studio e confronto con Opinion Leader, professionisti ed esperti consente di continuare a fare **ricerca** e sviluppare **soluzioni innovative**, in un'ottica di miglioramento continuo.

A completamento della già ricca gamma implantoprotesica, IESS offre anche tutte le soluzioni necessarie per affrontare le sfide della chirurgia orale di oggi, con prodotti e servizi dedicati al **workflow digitale**, alle **riabilitazioni avanzate** e al **mantenimento** del successo implantare a lungo termine.

"PERCHÉ IL **SORRISO** PIÙ PREZIOSO
È QUELLO CHE DURA NEL TEMPO"

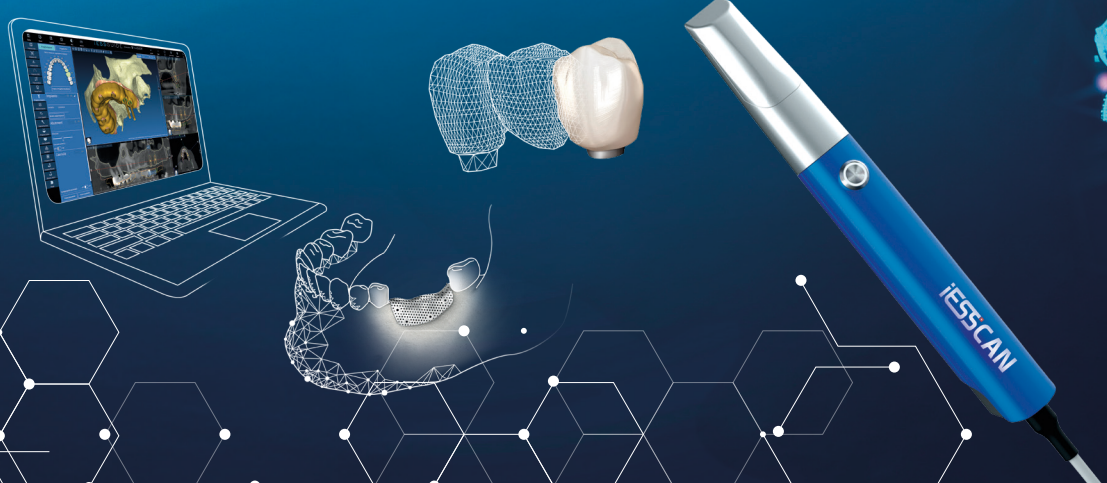

LEGENDA

MATERIALI

- Inox — Acciaio inossidabile
- Al — Alluminio
- EVA — Etilene vinil acetato
- PEEK — Polietereterchetone
- PA — Poliammide
- PPSU — Polifenilsulfone
- PMMA — Polimetilmetacrilato
- POM — Poliossimetilene
- SI — Silicone
- Ti — Titanio

COMPONENTI PROTESICHE

 non rotante

 rotante

ABBREVIAZIONI

- **H** — altezza
- **L** — lunghezza
- **ø** — diametro

Le misure riportate a catalogo sono espresse in mm.
Le immagini raffigurate sono esclusivamente rappresentative dei prodotti.

INDICE

Legenda	4
Sistema implantare iRES	6
Packaging	8
Preparazione del sito implantare	9
Sequenza chirurgica	10
Organizzatori chirurgici	16
Accessori - Frese	19
Countersink	20
Maschiatori	21
Connettori	22
Chiavi e cacciaviti	24
Impianti Bone Level	26
iMAX NHSI	27
VOLUTION SVB	28
SHAPEONE S1B	29
Componenti protesiche	30
HANDY HNDC	38
iMAX NHSIC	39
Componenti protesiche	40
iMAX NHSE	44
Componenti protesiche	45
Accessori iRETOR	51
Componenti MUA	52
Impianti Tissue Level	54
SHAPEONE S1T	55
Componenti protesiche	56
SHAPEONE S1TN	58
Componenti protesiche	59
iMAX MUA NHSM	60
Componenti protesiche	61
SHAPEMINI SM	63
Componenti protesiche	63
Impianti Pterigoidei	64
Impianti Zigomatici	65
Digitals	66
Chirurgia guidata	67
Advanced	74
Altri prodotti	75
Education	76
Avvertenze e condizioni di vendita	77

SISTEMA IMPLANTARE **iRES**


TRATTAMENTO DI SUPERFICIE

Esiste un'ampia letteratura scientifica* su come le caratteristiche di rugosità superficiale influenzino il comportamento cellulare. Rispetto ad una superficie liscia, i motivi topografici di dimensione inferiore a quella della cellula fibroblastica (micro e nanotopografia) orientano la disposizione delle cellule e stimolano l'attività osteoblastica e piastrinica, accelerando il processo di produzione di matrice extracellulare e la rigenerazione ossea e quindi l'osteintegrazione dell'impianto dentale. I tre **fondamenti del trattamento superficiale degli impianti dentali** in ottica biologica sono:


1. **controllo della topografia superficiale** per stimolare la risposta cellulare in direzione osteogenica;
2. **controllo della composizione chimica della superficie** per favorire la colonizzazione cellulare;
3. **controllo della contaminazione biologica** da endotossine adese per non interferire con la risposta infiammatoria naturale.

HYHA IBRIDO


Parziale trattamento di superficie sul corpo dell'impianto. Decontaminati con plasma a freddo*.



MAG 52 X - WD 11.5 mm
EHT 20.00 kV
Signal A CZ BSD




MAG 200 X - WD 11.0 mm
EHT 20.00 kV
Signal A CZ BSD




MAG 1.50 K X - WD 11.5 mm
EHT 20.00 kV
Signal A SE1

C NECK COLLO MACCHINATO

Trattamento di superficie sul corpo dell'impianto.



Sa 0,50 µm - valore medio complessivo su area di misura 30x30µm decontaminazione con plasma a freddo




Sa 1,90 µm - valore medio complessivo su area di misura 30x30µm sabbiatura doppia acidatura, decontaminazione con plasma a freddo.

Per il trattamento di superficie è stato utilizzato un processo di sabbiatura seguito da un doppio attacco con acido. Nelle immagini, aumentando gli ingrandimenti, è possibile osservare come gli aspetti macroscopici (spira, tagliente) dell'impianto non vengono intaccati dal trattamento e che la superficie è esente da residui di lavorazione. Si osserva chiaramente la rugosità a doppio raggio tipica del trattamento SLA, che contiene grosse cavità dovute alla sabbiatura large grit sulle quali è sovrimpressa la microrugosità dovuta al trattamento con acidi.
La microrugosità illustrata nelle figure evidenzia la tipica topografia tridimensionale, che impartisce a queste superfici caratteristiche di "spugna" che sono alla base delle loro eccellenti prestazioni cliniche. Infatti, la distanza picco molto breve, dell'ordine di circa 1 micrometro, stimola sia l'attività di cellule osteogeniche che la penetrazione capillare del sangue nella struttura superficiale, offrendo caratteristiche molto favorevoli per stimolare la rigenerazione ossea, come descritto in molti articoli su questo argomento. Questa combinazione unica di rugosità a lungo (large grit sandblasting) e corto range (acid etching) è un substrato favorevole alla ricrescita cellulare tale da promuoverne adeguatamente la differenziazione cellulare.
Il grado di rugosità è di Ra 1.42 ± 0.12.


TEST DI **TOSSICITÀ**

EN ISO 10993-5: 2009
VALUTAZIONE BIOLOGICA DEI DISPOSITIVI MEDICI
PROVE PER LA CITOTOSSICITÀ IN VITRO


Gli impianti, dopo trattamento e decontaminazione, si sono dimostrati perfettamente citocompatibili, cioè privi di effetti citotossici nei confronti dei fibroblasti L929. In tutti i pozzetti, le cellule hanno sempre evidenziato densità e morfologia del tutto confrontabili con quelle del controllo negativo. I fibroblasti proliferano in modo omogeneo a contatto con gli impianti in quanto dal materiale non viene rilasciato alcun elemento citotossico. Inoltre, non sono mai state evidenziate cellule giganti multinucleate in numero significativamente maggiore rispetto al controllo negativo, ad indicazione dell'assenza di effetti di tipo infiammatorio.



controllo **negativo**



controllo **positivo**



controllo **esaminato**

DECONTAMINAZIONE AL PLASMA


Dopo il trattamento di superficie, gli impianti vengono puliti dai residui di lavorazione mediante lavaggi con ultrasuoni ad alcoli modificati e quindi sottoposti ad un processo di decontaminazione superficiale mediante plasma freddo (Argon). Gli atomi parzialmente ionizzati dell'Argon (gas inerte) agiscono come un'ulteriore sabbiatura atomica che promuove la rimozione dei contaminanti organici ed attiva la ionizzazione degli atomi superficiali del titanio, migliorando la bagnabilità dell'impianto. Le condizioni di trattamento adottate sugli impianti forniscono le migliori caratteristiche ritenute importanti, allo stato della conoscenza attuale**, nei processi di guarigione implantare, sia in termini di morfologia superficiale che in termini di composizione chimica (pulizia della superficie).
La pulizia con plasma, la pratica di confezionamento in ambiente controllato, l'assoluto rispetto di procedure "pulite", i test di controllo qualità durante il processo produttivo, giocano un ruolo fondamentale nel controllo delle endotossine adese (pulizia biologica), principale agente di risposta immunologica alle superfici implantari.

** Valutazione della composizione chimica superficiale, della morfologia, della citotossicità e dell'adesione cellulare su impianti dentali. G. Cascardo, C. Cassinelli. Doctor OS 2005 Nov-Dic; 16 (9): 1091. Valutazione comparativa del trattamento di superficie in 5 sistemi implantari. M. Biasotto, M. Cadenaro et al. Università degli studi di Trieste. Quintessence International, Anno 18 – Maggio/Giugno 2002. RAPPORTO ISTISAN 01/15 – Valutazione del trattamento superficiale sulle prestazioni meccaniche a fatica di impianti in titanio plasma-sprayed e titanio sabbiato e mordenzato. Rossella Bedini, Gior-gio de Angelis, Marco Tallarico, Rosario Iealpi, Umberto Romeo, Giuseppe di Cintio 2001, 33 p. RAPPORTO ISTISAN 08/32 – Valutazione microtomografica dell'area di possibile contatto osseo di sei tipologie diverse di impianti dentali. Rossella Bedini, Raffaella Pec-ci, Fabio Di Carlo, Alessandro Quaranta, Francesca Rizzo, Manlio Quaranta, G. Heimke, W. Schulte, B. d'Hoedt, P. Griss, C.M. Büsing, D. Stock. The influence of fine surface structures on the osseo-integration of implants. The International Journal of Artificial Organs 1982; 5(3): 207-212. Guy, M.J. McQuade, M.J. Scheidt, J.C. McPherson III, J.A. Rossmann, T.E. Van Dyke. In vitro attachment of human gingival fibroblasts to endosse-ous implant materials. Journal of Periodontology 1993 Jun; 64(6): 542-546.*

*** Valutazione del rapporto tra costo e qualità della pulizia superficiale di alcuni sistemi implantari in commercio Marco Morra, Clara Cassinelli, Giovanna Cascardo, Daniele Bollati, Nobil Bio Ricerche srl Via Valcastellana 26, 14037, Portacomaro (AT)*
M. Morra, C.Cassinelli, Evaluation of Surface Contamination of Titanium Dental Implants by Lu-Sem: Comparation with XPS Mesurements Surface and Interface Analysts, Vol. 25, 983-984 (1997).

PACKAGING

Per preservarne l'integrità, l'impianto dentale è alloggiato in posizione verticale all'interno di un cilindro in titanio ancorato, tramite il tappo di chiusura, al rispettivo flacone di vetro borosilicato ad uso farmaceutico conforme alla Farmacopea Europea vigente.* Tale flacone garantisce realmente la neutralità del confezionamento primario per l'assenza di rilascio di contaminanti durante la fase di sterilizzazione. È inserito all'interno di un blister in polyglass trasparente sigillato con Tyvek laccato termosaldante e confezionato in una scatoletta di cartone contenente anche le istruzioni per l'uso e le etichette per la scheda paziente, su cui sono riportati i dati che consentono la tracciabilità del prodotto (numero di codice e lotto). Tutti i materiali usati per il packaging del prodotto sono stati testati, validati e certificati.

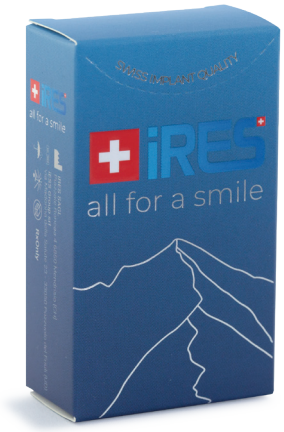

ETICHETTA INFORMATIVA



QR code per **IFU elettroniche**

Etichetta con **due porzioni rimovibili** per passaporto implantare e cartella clinica



Legenda simboli

- REF — Numero di catalogo
- LOT — Codice di lotto
- Data di fabbricazione
- Utilizzabile entro la data
- Non risterilizzabile
- Non riutilizzare
- STERILE R — Sterilizzato con raggi ionizzanti
- Sistema a barriera sterile singola con packaging protettivo interno
- Consultare le Istruzioni d'Uso
- Attenzione
- CE 0426 — Conformità dei dispositivi medici al Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745

STERILIZZAZIONE

Gli impianti vengono forniti sterili, in una confezione che permette di garantirne la sterilità per 5 anni. Il processo di sterilizzazione viene effettuato con raggi gamma nel rispetto delle normative vigenti presso fornitori qualificati che utilizzano sistemi automatizzati, sicuri ed affidabili, con monitoraggio microbiologico continuo del processo.

PREPARAZIONE DEL **SITO IMPLANTARE**

Le modalità e gli strumenti per la preparazione del sito sono comuni per tutte le linee e dipendono esclusivamente dal diametro dell'impianto e dalla tipologia di osso*.

D1 — **Osso corticale denso**, che richiede una ulteriore svasatura del foro. La sequenza chirurgica prevede, dopo la sequenza standard, il passaggio di una fresa finale dello stesso diametro dell'impianto ma più corta, da affondare fino alla profondità definitiva.



D2-D3 — **Osso corticale denso/poroso**, con struttura trabecolare fitta, oppure osso corticale poroso e sottile, con struttura trabecolare fine. La sequenza chirurgica è quella standard.



D4** — **Osso corticale praticamente inesistente**, con struttura trabecolare fine, che richiede una sottopreparazione del sito. La sequenza chirurgica prevede che l'ultima fresa finale sia la più corta disponibile.




* La classificazione è quella elaborata da Misch (Bone character: second vital implant criterion, Dent Today 7:39-40, 1998), che distingue quattro tipologie di densità ossea sulla base delle caratteristiche macroscopiche dell'osso corticale e trabecolare proprie della porzione edentula da trattare.
** Non è previsto in caso di osso D4.

GARANZIA IMPLANTARE

Una **garanzia** di affidabilità offerta **a vita** sulla gamma di **impianti** e **componenti protesiche** grazie a:
- **affidabilità** tecnica data da un **know-how trentennale**;
- **affidabilità clinica** di un protocollo applicato **da oltre vent'anni**.


SEQUENZA **CHIRURGICA** ALTEZZE DA **8** A **16** mm

iMAX NHSI iMAXMUA NHSM iMAX NHSIC

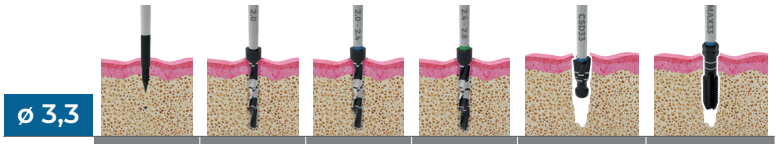


ø 3,3	Fresa lancia	Fresa 2,0	Fresa 2,0|2,4	Fresa 2,4|2,8	Countersink* 3,3	Maschiatore 3,3
osso D4	•	•	•			
osso D2-D3	•	•	•	•	•	
osso D1	•	•	•	•	•	•

iMAX NHSI iMAXMUA NHSM iMAX NHSIC SHAPEONE

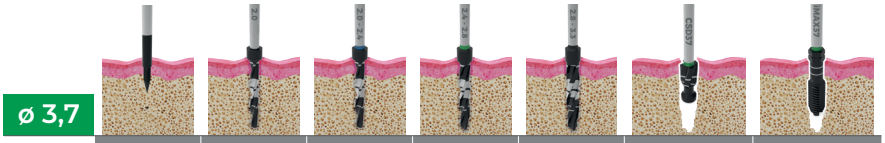


ø 3,7	Fresa lancia	Fresa 2,0	Fresa 2,0|2,4	Fresa 2,4|2,8	Fresa 2,8|3,3	Countersink* 3,7	Maschiatore 3,7
osso D4	•	•	•	•			
osso D2-D3	•	•	•	•	•	•	
osso D1	•	•	•	•	•	•	•

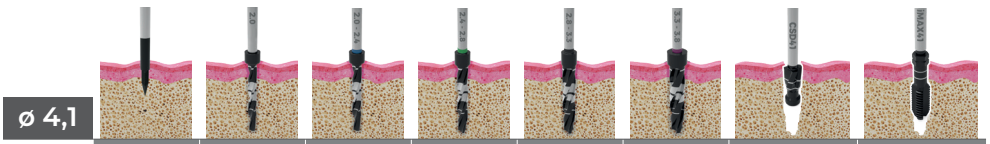


ø 4,1	Fresa lancia	Fresa 2,0	Fresa 2,0|2,4	Fresa 2,4|2,8	Fresa 2,8|3,3	Fresa 3,3|3,8	Countersink* 4,1	Maschiatore 4,1
osso D4	•	•	•	•	•			
osso D2-D3	•	•	•	•	•	•	•	
osso D1	•	•	•	•	•	•	•	•

iMAX NHSI iMAX NHSIC SHAPEONE

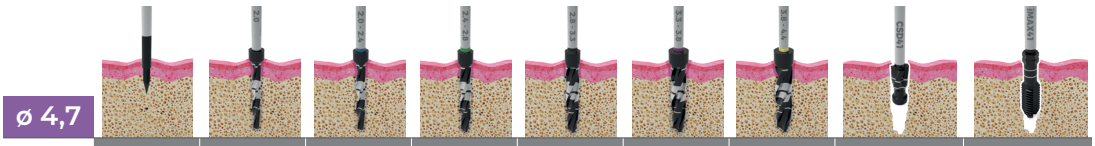


ø 4,7	Fresa lancia	Fresa 2,0	Fresa 2,0|2,4	Fresa 2,4|2,8	Fresa 2,8|3,3	Fresa 3,3|3,8	Fresa 3,8|4,4	Countersink* 4,7	Maschiatore 4,7
osso D4	•	•	•	•	•	•			
osso D2-D3	•	•	•	•	•	•	•	•	
osso D1	•	•	•	•	•	•	•	•	•

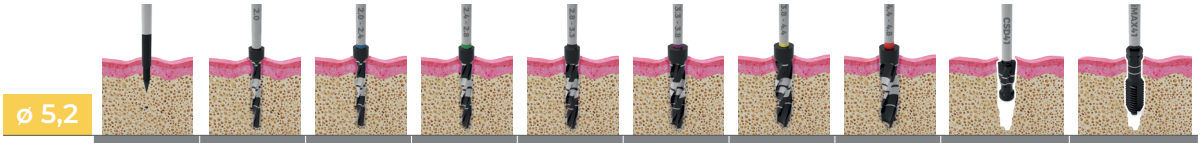

ø 5,2	Fresa lancia	Fresa 2,0	Fresa 2,0|2,4	Fresa 2,4|2,8	Fresa 2,8|3,3	Fresa 3,3|3,8	Fresa 3,8|4,4	Fresa 4,4|4,8	Countersink* 5,2	Maschiatore 5,2
osso D4	•	•	•	•	•	•	•			
osso D2-D3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
osso D1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•


HANDY HNDC VOLUTION SVB

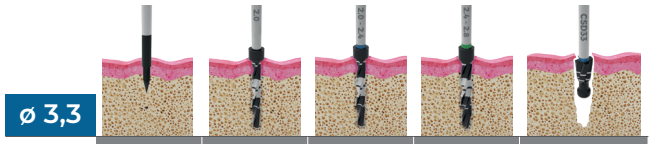

ø 3,3	Fresa lancia	Fresa 2,0	Fresa 2,0|2,4	Fresa 2,4|2,8	Countersink* 3,3
osso D4	•	•	•		
osso D2-D3	•	•	•	•	•
osso D1	•	•	•	•	•


! * Affondare la **countersink**:
- sino a **1,4 mm** per osso **medio D3**
- sino a **2,8 mm** per osso **medio D2** e per osso compatto **D1**

HANDY HNDC VOLUTION SVB

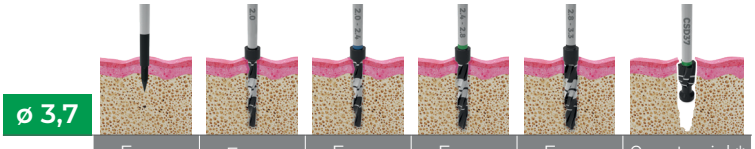


ø 3,7

	Fresa lancia	Fresa 2,0	Fresa 2,0|2,4	Fresa 2,4|2,8	Fresa 2,8|3,3	Countersink* 3,7
osso D4	•	•	•	•		
osso D2-D3	•	•	•	•	•	•
osso D1	•	•	•	•	•	•

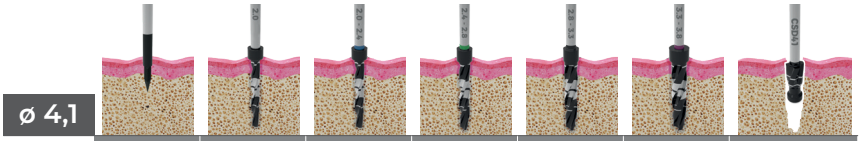


ø 4,1

	Fresa lancia	Fresa 2,0	Fresa 2,0|2,4	Fresa 2,4|2,8	Fresa 2,8|3,3	Fresa 3,3|3,8	Countersink* 4,1
osso D4	•	•	•	•	•		
osso D2-D3	•	•	•	•	•	•	•
osso D1	•	•	•	•	•	•	•

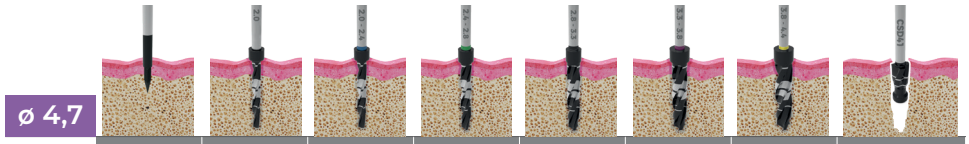

ø 4,7

	Fresa lancia	Fresa 2,0	Fresa 2,0|2,4	Fresa 2,4|2,8	Fresa 2,8|3,3	Fresa 3,3|3,8	Fresa 3,8|4,4	Countersink* 4,7
osso D4	•	•	•	•	•	•		
osso D2-D3	•	•	•	•	•	•	•	•
osso D1	•	•	•	•	•	•	•	•

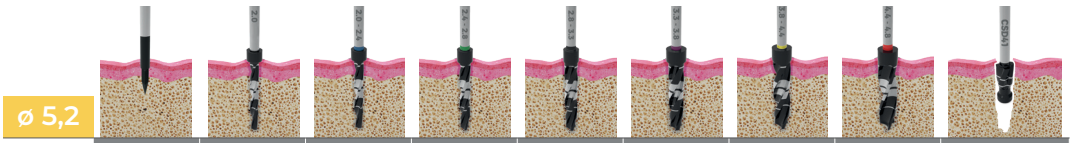


ø 5,2

	Fresa lancia	Fresa 2,0	Fresa 2,0|2,4	Fresa 2,4|2,8	Fresa 2,8|3,3	Fresa 3,3|3,8	Fresa 3,8|4,4	Fresa 4,4|4,8	Countersink* 5,2
osso D4	•	•	•	•	•	•	•		
osso D2-D3	•	•	•	•	•	•	•	•	•
osso D1	•	•	•	•	•	•	•	•	•

SEQUENZA **CHIRURGICA**


IMPIANTI CORTI

iMAX NHSI

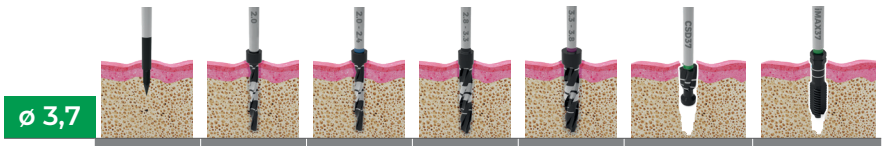


ø 3,7	Fresa lancia	Fresa 2,0	Fresa 2,0|2,4	Fresa 2,8|3,3	Fresa 3,3|3,8	Countersink* 3,7	Maschiatore 3,7
osso D4	•	•	•	•			
osso D2-D3	•	•	•	•	•	•	
osso D1	•	•	•	•	•	•	•

iMAX NHSI iMAX NHSIC SHAPEONE

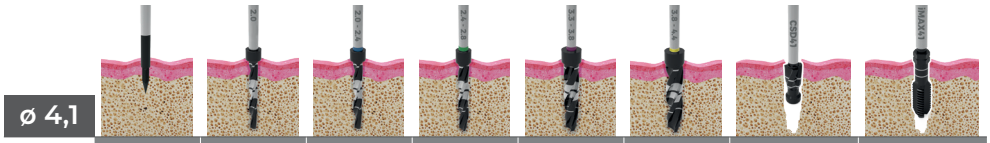

ø 4,1	Fresa lancia	Fresa 2,0	Fresa 2,0|2,4	Fresa 2,4|2,8	Fresa 3,3|3,8	Fresa 3,8|4,4	Countersink* 4,1	Maschiatore 4,1
osso D4	•	•	•	•	•			
osso D2-D3	•	•	•	•	•	•	•	
osso D1	•	•	•	•	•	•	•	•


iMAX NHSI iMAX NHSIC

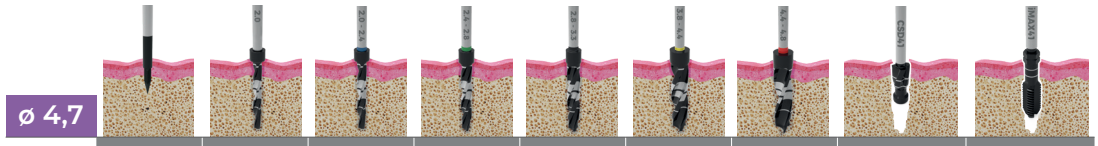

ø 4,7	Fresa lancia	Fresa 2,0	Fresa 2,0|2,4	Fresa 2,4|2,8	Fresa 2,8|3,3	Fresa 3,8|4,4	Fresa 4,4|4,8	Countersink* 4,7	Maschiatore 4,7
osso D4	•	•	•	•	•	•			
osso D2-D3	•	•	•	•	•	•	•	•	
osso D1	•	•	•	•	•	•	•	•	•


! * Affondare la **countersink**:
- sino a **1,4 mm** per osso **medio D3**
- sino a **2,8 mm** per osso **medio D2** e per osso compatto **D1**

iMAX NHSI — iMAX NHSIC

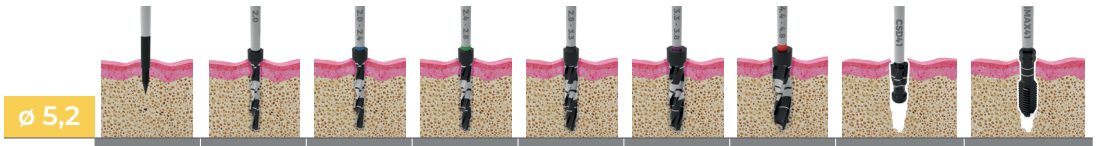


ø 5,2	Fresa lancia	Fresa 2,0	Fresa 2,0|2,4	Fresa 2,4|2,8	Fresa 2,8|3,3	Fresa 3,3|3,8	Fresa 4,4|4,8	Countersink* 5,2	Maschiatore 5,2
osso D4	•	•	•	•	•	•	•		
osso D2-D3	•	•	•	•	•	•	•	•	
osso D1	•	•	•	•	•	•	•	•	•

HANDY HNDC — VOLUTION SVB

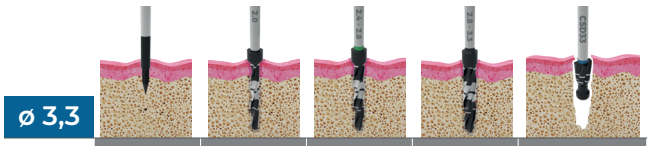


ø 3,3	Fresa lancia	Fresa 2,0	Fresa 2,4|2,8	Fresa 2,8|3,3	Countersink* 3,3
osso D4	•	•	•		
osso D2-D3	•	•	•	•	•
osso D1	•	•	•	•	•

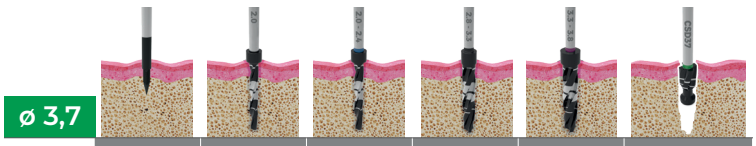


ø 3,7	Fresa lancia	Fresa 2,0	Fresa 2,0|2,4	Fresa 2,8|3,3	Fresa 3,3|3,8	Countersink* 3,7
osso D4	•	•	•	•		
osso D2-D3	•	•	•	•	•	•
osso D1	•	•	•	•	•	•


HANDY HNDC VOLUTION SVB

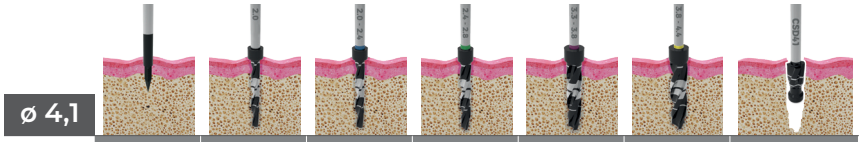

ø 4,1	Fresa lancia	Fresa 2,0	Fresa 2,0|2,4	Fresa 2,4|2,8	Fresa 3,3|3,8	Fresa 3,8|4,4	Countersink* 4,1
osso D4	•	•	•	•	•		
osso D2-D3	•	•	•	•	•	•	•
osso D1	•	•	•	•	•	•	•

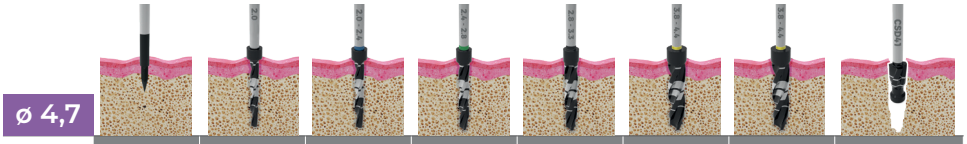

ø 4,7	Fresa lancia	Fresa 2,0	Fresa 2,0|2,4	Fresa 2,4|2,8	Fresa 2,8|3,3	Fresa 3,8|4,4	Fresa 4,4|4,8	Countersink* 4,7
osso D4	•	•	•	•	•	•		
osso D2-D3	•	•	•	•	•	•	•	•
osso D1	•	•	•	•	•	•	•	•

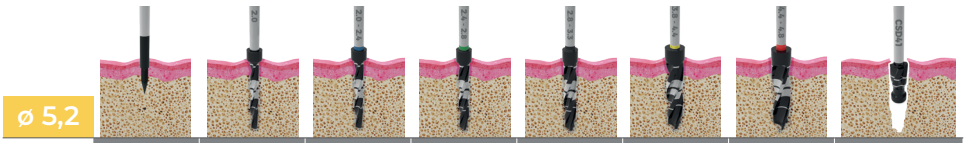

ø 5,2	Fresa lancia	Fresa 2,0	Fresa 2,0|2,4	Fresa 2,4|2,8	Fresa 2,8|3,3	Fresa 3,8|4,4	Fresa 4,4|4,8	Countersink* 5,2
osso D4	•	•	•	•	•	•		
osso D2-D3	•	•	•	•	•	•	•	•
osso D1	•	•	•	•	•	•	•	•

! * Affondare la **countersink**:
- sino a **1,4 mm** per osso **medio D3**
- sino a **2,8 mm** per osso **medio D2** e per osso compatto **D1**

ORGANIZZATORI CHIRURGICI

KIT CHIRURGICO
CSK

	CSK
PPSU SI	*2.625 €*

Unico kit chirurgico per tutte le linee implantari.
I vassoi chirurgici hanno lo scopo di conservare gli strumenti che vengono utilizzati per inserire gli impianti dentali.
I vassoi così assemblati possono essere trasportati, sterilizzati e conservati in posizione orizzontale e con il coperchio chiuso. Tutto lo strumentario deve essere pulito e sterilizzato per il primo utilizzo.
Il kit e lo strumentario all'interno non sono sterili al momento della consegna.
I kit standard contengono i connettori per esagono interno:
i connettori per le altre connessioni sono disponibili su ordinazione.



DE	prolunga per fresa
LD	fresa lancia
D20M	fresa pilota ø 2,0
D2024M	fresa ø 2,0|2,4
CSD33	countersink ø 3,3
D2428M	fresa ø 2,4|2,8
CSD37	countersink ø 3,7
D2833M	fresa ø 2,8|3,3
CSD41	countersink ø 4,1
D3338M	fresa ø 3,3|3,8
CSD47	countersink ø 4,7
D3844M	fresa ø 3,8|4,4
CSD52	countersink ø 5,2
D4448M	fresa ø 4,4|4,8

DS43341M	stop 4.5
DS63341M	stop 6,5
DS83341M	stop 8
DS103341M	stop 10
DS113341M	stop 11.5
DS133341M	stop 13
TWA4	cricchetto completo
THDDS	cacciavite da contrangolo corto per esagono 1,25
THDDL	cacciavite da contrangolo lungo per esagono 1,25
HDH21S	connettore corto esagono interno 2,1
HDH21L	connettore lungo esagono interno 2,1
HDH25S	connettore corto esagono interno 2,5
HDH25L	connettore lungo esagono interno 2,5
PP	perni di parallelismo 0°

KIT CHIRURGICO
SMALL





COMPLETE

Ergo Kit

PPSU | SI

2.980 €

LD	fresa lancia
D20M	fresa pilota ø 2,0
D2024M	fresa ø 2,0|2,4
CSD33	countersink ø 3,3
D2428M	fresa ø 2,4|2,8
CSD37	countersink ø 3,7
D2833M	fresa ø 2,8|3,3
CSD41	countersink ø 4,1
D3338M	fresa ø 3,3|3,8
CSD47	countersink ø 4,7
D3844M	fresa ø 3,8|4,4
CSD52	countersink ø 5,2
D4448M	fresa ø 4,4|4,8
THDDL	cacciavite lungo da contrangolo per esagono 1,25
HDH21L	connettore lungo per esagono 2,1
HDH25L	connettore lungo per esagono 2,5
DE	prolunga per fresa
TAPXXX33*	maschiatore ø 3,3
TAPXXX37*	maschiatore ø 3,7
TAPXXX41*	maschiatore ø 4,1
TAPXXX47*	maschiatore ø 4,7
TAPXXX52*	maschiatore ø 5,2
PP	perni di parallelismo 0°
THDDS	cacciavite corto da contrangolo per esagono 1,25
HDH21S	connettore corto per esagono 2,1
HDH25S	connettore corto per esagono 2,5
MDS	cacciavite manuale corto per esagono 1,25
MDL	cacciavite manuale lungo per esagono 1,25
MDLAA	cacciavite manuale angolato per torx
TWA4	cricchetto completo
DS43341M	stop 4,5
DS63341M	stop 6,5
DS83341M	stop 8
DS103341M	stop 10
DS113341M	stop 11,5
DS133341M	stop 13

BASIC

BSK

PPSU | SI

1.880 €

LD	fresa lancia
D20M	fresa pilota ø 2,0
D2024M	fresa ø 2,0|2,4
CSD33	countersink ø 3,3
D2428M	fresa ø 2,4|2,8
CSD37	countersink ø 3,7
D2833M	fresa ø 2,8|3,3
CSD41	countersink ø 4,1
D3338M	fresa ø 3,3|3,8
CSD47	countersink ø 4,7
D3844M	fresa ø 3,8|4,4
CSD52	countersink ø 5,2
D4448M	fresa ø 4,4|4,8
THDDL	cacciavite lungo da contrangolo per esagono 1,25
HDH21L	connettore lungo per esagono 2,1
HDH25L	connettore lungo per esagono 2,5
TWA4	cricchetto completo

KIT **PROTESICO**

KIT PROTESICO

PSK

	PSK
PPSU SI	*945 €*

MDXS	cacciavite manuale extracorto per esagono 1,25
MDS	cacciavite manuale corto per esagono 1,25
MDL	cacciavite manuale lungo per esagono 1,25
MDLAA	cacciavite manuale per torx angolato
TRT	estrattore per monconi
MTRT	estrattore manuale per monconi
HDH20	connettore per MUA dritti
HDH25M	connettore per Shape Mini
THDDS	cacciavite da contrangolo corto per esagono 1,25
THDDL	cacciavite da contrangolo lungo per esagono 1,25
THDDAL	cacciavite da contrangolo per torx angolato
TWA4	cricchetto dinamometrico



PROCEDURA PER LA **GESTIONE** DEI **KIT**

PULIZIA

1. Smontare tutti i pezzi composti.
2. Sciacquare abbondantemente con acqua fredda o tiepida per 2,5 minuti.
3. Lasciare gli strumenti per 10 minuti in un pulitore ad ultrasuoni con un detergente enzimatico a pH neutro diluito in acqua secondo le istruzioni del prodotto.
4. Lavare con acqua per 3 minuti.

STERILIZZAZIONE

In autoclave sotto vuoto e sterilizzare con le seguenti modalità:
temperatura = 121 ÷124°C con ciclo autoclave minimo di 20 minuti e ciclo di asciugatura di 15 minuti.



ACCESSORI

PERNI DI PARALLELISMO

0°	PP
TI	21 €



ORIENTATORE DI POSIZIONE PER IMAX MUA

0°	NHSMFL
TI POM	22 €



GUIDA PER INCLINAZIONE FRESE


0° - 18° - 30°	NHSMG
TI	126 €



FRESE

Per eseguire correttamente un'osteotomia preservando la qualità dell'osso, si raccomanda una velocità massima di 800 rpm con irrigazione diretta per il raffreddamento. Le frese, in acciaio medicale, e sottoposte ad un trattamento termico di indurimento possono essere utilizzate fino a un massimo di 30 volte. Le frese elicoidali presentano marcature laser per indicare la profondità da raggiungere, a 8 mm con una linea bianca sottile, da 10 a 13 mm con una fascia bianca nella cui metà viene indenficata l'altezza da 11,5 mm, ed infine una sottile linea bianca che segnala i 16 mm. Questo sistema conferisce un colpo d'occhio chiaro ed intuitivo del livello di profondità raggiunta dalla fresa. Non si è voluto demarcare i 4,5 ed i 6,5 mm per non creare confusione nella lettura delle linee di demarcazione, ed essendo tali misure molto vicine al nervo, si raccomanda sempre l'utilizzo degli stop da 4,5 e 6,5 mm. Le frese da **2,0 a 2,8/3,3** hanno **apice tagliente**.
Le frese da **33/38** - **38/44** - **44/48** hanno **apice piatto**, non aumentano l'altezza del taglio, ma servono solo per allargare l'osteotomia. **Non devono essere utilizzate per il taglio, ma come ausilio per l'inserimento dell'impianto**.

Cilindrica | **Doppia Cilindrica**

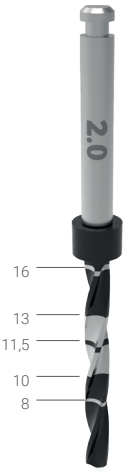

ø 2,0



ø 2,0/2,4



ø 2,0/2,4 - 2,8/3,3
3,3/3,8 - 3,8/4,4
4,4/4,8

PROLUNGA PER FRESE

	DE
Inox	42 €



FRESA A LANCIA Ø 2

	LD
Inox	*47 €*



FRESA H 36

ø 2	D20M
ø 2,0|2,4	D2024M
ø 2,4|2,8	D2428M
ø 2,8|3,3	D2833M
ø 3,3|3,8	D3338M
ø 3,8|4,4	D3844M
ø 4,4|4,8	D4448M
Inox	*74 €*



STOP PER FRESE 2,0 - 2,0/2,4 - 2,4/2,8 - 2,8/3,3

H	
4,5	DS43341M
6,5	DS63341M
8	DS83341M
10	DS103341M
11,5	DS113341M
13	DS133341M
TI	*37 €*



La lunghezza degli stop varia da **4,5 mm a 13 mm**. Le frese da 33/38 - 38/44 - 44/48 non prevedono stop in quanto sono caratterizzate da una punta piatta.

COUNTERSINK

I countersink (svasatori) vengono utilizzati quando c'è la necessità di **allargare la parte iniziale del foro** eseguito per adeguare la forma a quella del collo dell'impianto da inserire. La **velocità massima consigliata è 300 rpm** con apporto diretto sulla fresa di soluzione fisiologica per agevolare il raffreddamento. Il countersink dev'essere utilizzato in perfetto asse con l'osteotomia per evitare di ovalizzarla nella parte coronale. I countersink hanno **due marcature laser** di riferimento che identificano la profondità da raggiungere in base alla consistenza dell'osso, a **1,4 mm per un osso di tipo "D3"** a **2,8 mm per un osso di tipo "D2" e "D1"**. Sopra la marcatura a 2,8 mm la countersink continua con una geometria cilindrica che non compromette l'osteotomia anche se inserità più in profondità.



per impianti corti



senza peduncolo di inserimento

COUNTERSINK

ø 3,3	CSD33
ø 3,7	CSD37
ø 4,1	CSD41
ø 4,7	CSD47
ø 5,2	CSD52
Inox	*95 €*




COUNTERSINK IMPIANTI CORTI

ø 3,3	CSDS33
ø 3,7	CSDS37
ø 4,1	CSDS41
ø 4,7	CSDS47
ø 5,2	CSDS52
Inox	*95 €*



MASCHIATORI

In **osso particolarmente denso (tipo I) è consigliabile** utilizzare preventivamente un maschiatore dello stesso profilo dell'impianto da inserire. Il maggiore potere tagliente del maschiatore rispetto a quello di cui comunque anche l'impianto dispone, permette di preparare il sito con traumi ridotti. **La velocità massima consigliata è 30 rpm** con apporto diretto sul maschiatore di soluzione fisiologica per agevolare il raffreddamento.

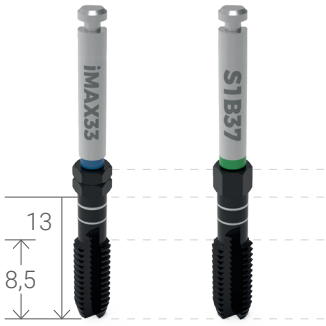

MASCHIATORI **SHAPEONE**

ø 3,7	TAPS1B37
ø 4,1	TAPS1B41
ø 4,7	TAPS1B47
Inox	*95 €*



MASCHIATORI **IMAX**

ø 3,3	TAPIMAX33
ø 3,7	TAPIMAX37
ø 4,1	TAPIMAX41
ø 4,7	TAPIMAX47
ø 5,2	TAPIMAX52
Inox	*95 €*



MUCOTOMI

ø 3,3	HDHCSN
ø 4	HDHCSR
Inox	*50 €*




CONNETTORI

Nel kit i connettori hanno tutti un attacco da manipolo che grazie alla speciale rondella (WH2) potranno essere utilizzati sia in modalità manuale che con il cricchetto.
I torque di inserimento per il **carico immediato** dovranno essere compresi nel range **da 35 a 50Ncm**. Per il **carico convenzionale** il torque di inserimento non dovrà **mai essere superiore** a **50Ncm**.



CONNETTORI PER ESAGONO INTERNO NARROW

ø	H	
2,1	25	HDH21S
2,1	30	HDH21L
Inox		*47 €*

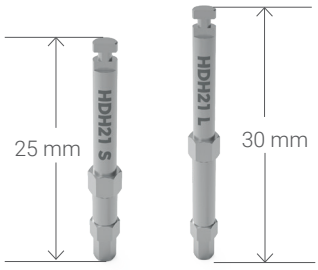

CONNETTORI PER ESAGONO ESTERNO NARROW

ø	H	
2,4	25	HDH24S
2,4	30	HDH24L
Inox		*47 €*



CONNETTORI PER ESAGONO INTERNO **REGULAR**

ø	H	
2,5	25	HDH25S
2,5	30	HDH25L

Inox — *47 €*



CONNETTORI PER **ESAGONO ESTERNO REGULAR**

ø	H	
2,7	25	HDH27S
2,7	30	HDH27L


Inox — *47 €*



CONNETTORI PER **OTTAGONO**

ø	H	
3,1	25	HDH31S
3,1	30	HDH31L

Inox — *47 €*



CONNETTORI PER **MUA DRITTI**

	HDH20

Inox — *47 €*



CONNETTORI PER **SHAPE MINI**

	HDH25M

Inox — *47 €*



CONNETTORI PER **IMAX MUA**

	NHSMHDH

Inox — *47 €*



CHIAVI E CACCIAVITI

CACCIAVITI PROTESICI

Cacciavite da contrangolo per esagono

corto	THDDS
lungo	THDDL
Inox	*47 €*



Cacciavite manuale per esagono

extra corto	MDXS
corto	MDS
lungo	MDL
extra lungo	MDXL
Inox	*47 €*



Cacciavite manuale per torx angolato

	MDLAA
Inox	*68 €*



Cacciavite da contrangolo per torx angolato

	THDDAL
Inox	*47 €*



AVVITATORI

	IDL
Inox	*68 €*



Per iRetor

	8393
Inox	*100 €*



ESTRATTORI PER IMPIANTI

	TRI
Inox	*100 €*



ESTRATTORI PER MONCONI

a motore	TRT
manuale	MTRT
Inox	*100 €*



KIT PER ESTRAZIONE VITI DI RITENZIONE

Da usare in modalità "**reverse**" a 30 rpm

fresa	D15RS
Inox	*116 €*



guida per fresa	GRS
TI	*63 €*

Versione dedicata per la connessione ad esagono interno 2,5



supporto per GRS	SGRS
TI	*105 €*




CRICCHETTO

completo	TWA4
Inox	*294 €*
adattatore (ricambio)	WH2
Inox	*53 €*
cricchetto senza adattatore	*TW4*
Inox	*242 €*



Cricchetto fisso reverse: consente di avvitare e svitare senza dover estrarre e girare l'adattatore
Braccio dinamometrico: montato sul cricchetto reverse consente di misurare fino a 70Ncm senza rompere l'asta grazie al fermo corsa finale



Alloggiamento per rondella da 8 mm per conferire maggior resistenza ai torque più elevati.




Sopra i 70 Ncm è presente un fermo di sicurezza per evitare la fuoriuscita del braccio di trascinamento, evitandone la rottura.




Reverse per cambiare verso di svitamento e avvitamento senza dover togliere e riposizionare il cricchetto.

IMPIANTI
BONE LEVEL

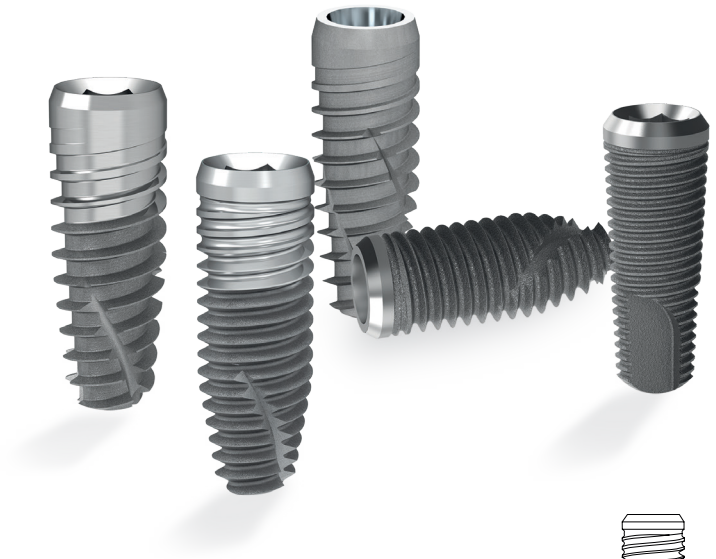

iMAX NHSI

ESAGONO INTERNO **ø 3,3 - 3,7 - 4,1 - 4,7 - 5,2**




VOLUTION SVB

ESAGONO INTERNO **ø 3,3 - 3,7 - 4,1 - 4,7 - 5,2**



SHAPEONE S1B

ESAGONO INTERNO **ø 3,7 - 4,1 - 4,7**




HANDY HNDC

CONNESSIONE CONOMETRICA **ø 3,3 - 3,7 - 4,1 - 4,7 - 5,2**




iMAX NHSIC

CONNESSIONE CONOMETRICA **ø 3,3 - 3,7 - 4,1 - 4,7 - 5,2**



iMAX NHSE

ESAGONO ESTERNO **ø 3,3 - 3,7 - 4,1 - 4,7 - 5,2**



Gli impianti dentali sono realizzati in titanio per uso medicale in conformità alle normative vigenti

iMAX NHSI

IMPIANTO UNIVERSALE PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI OSSO



ESAGONO INTERNO **2,1**
PIATTAFORMA **3,2**
FILETTO INTERNO **1/72**

ESAGONO INTERNO **2,5**
PIATTAFORMA **3,5**
FILETTO INTERNO **1/72**

Ø 3,3

L	IBRIDO	NECK
10	NHSI3410HYHA	NHSI3410C
11,5	NHSI3411HYHA	NHSI3411C
13	NHSI3413HYHA	NHSI3413C
16	NHSI3416HYHA	NHSI3416C

Ø 3,7

L	IBRIDO	NECK
8	NHSI3808HYHA	NHSI3808C
10	NHSI3810HYHA	NHSI3810C
11,5	NHSI3811HYHA	NHSI3811C
13	NHSI3813HYHA	NHSI3813C
16	NHSI3816HYHA	NHSI3816C

Ø 4,1

L	IBRIDO	NECK
6,5	NHSI4106HYHA	NHSI4106C
8	NHSI4108HYHA	NHSI4108C
10	NHSI4110HYHA	NHSI4110C
11,5	NHSI4111HYHA	NHSI4111C
13	NHSI4113HYHA	NHSI4113C
16	NHSI4116HYHA	NHSI4116C

Ø 4,7


L	IBRIDO	NECK
6,5	NHSI4706HYHA	NHSI4706C
8	NHSI4708HYHA	NHSI4708C
10	NHSI4710HYHA	NHSI4710C
11,5	NHSI4711HYHA	NHSI4711C
13	NHSI4713HYHA	NHSI4713C
16	NHSI4716HYHA	NHSI4716C


Ø 5,2

L	IBRIDO	NECK
6,5	NHSI5206HYHA	NHSI5206C
8	NHSI5208HYHA	NHSI5208C
10	NHSI5210HYHA	NHSI5210C
11,5	NHSI5211HYHA	NHSI5211C
13	NHSI5213HYHA	NHSI5213C

VOLUTION SVB

IMPIANTO A SPIRA LARGA PER UN'ELEVATA STABILITÀ PRIMARIA

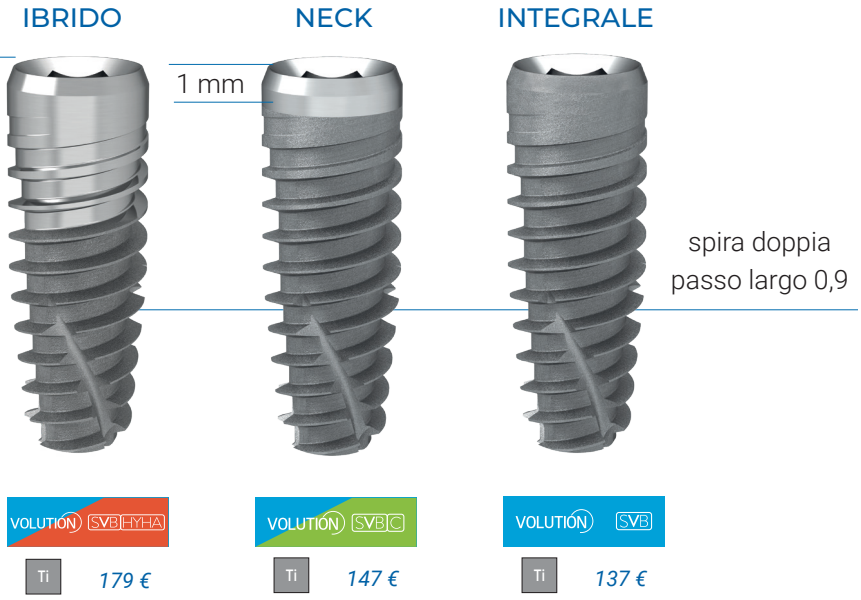

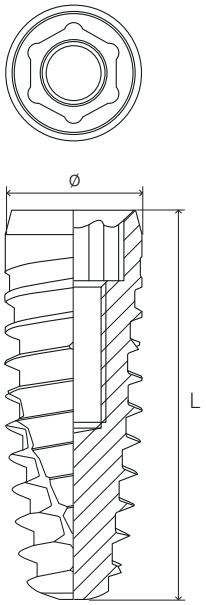

ESAGONO INTERNO **2,1**
PIATTAFORMA **3,2**
FILETTO INTERNO **1/72**

ESAGONO INTERNO **2,5**
PIATTAFORMA **3,5**
FILETTO INTERNO **1/72**

Ø 3,3

L	IBRIDO	NECK	INT.
8	SVB3408HYHA	SVB3408	SVB3408I
10	SVB3410HYHA	SVB3410	SVB3410I
11,5	SVB3411HYHA	SVB3411	SVB3411I
13	SVB3413HYHA	SVB3413	SVB3413I
16	SVB3416HYHA	SVB3416	SVB3416I

Ø 3,7

L	IBRIDO	NECK	INT.
6,5	SVB3806HYHA	SVB3806	SVB3806I
8	SVB3808HYHA	SVB3808	SVB3808I
10	SVB3810HYHA	SVB3810	SVB3810I
11,5	SVB3811HYHA	SVB3811	SVB3811I
13	SVB3813HYHA	SVB3813	SVB3813I
16	SVB3816HYHA	SVB3816	SVB3816I

Ø 4,1

L	IBRIDO	NECK	INT.
6,5	SVB4106HYHA	SVB4106	SVB4106I
8	SVB4108HYHA	SVB4108	SVB4108I
10	SVB4110HYHA	SVB4110	SVB4110I
11,5	SVB4111HYHA	SVB4111	SVB4111I
13	SVB4113HYHA	SVB4113	SVB4113I
16	SVB4116HYHA	SVB4116	SVB4116I

Ø 4,7

L	IBRIDO	NECK	INT.
6,5	SVB4706HYHA	SVB4706	SVB4706I
8	SVB4708HYHA	SVB4708	SVB4708I
10	SVB4710HYHA	SVB4710	SVB4710I
11,5	SVB4711HYHA	SVB4711	SVB4711I
13	SVB4713HYHA	SVB4713	SVB4713I
16	SVB4716HYHA	SVB4716	SVB4716I

Ø 5,2


L	IBRIDO	NECK	INT.
6,5	SVB5206HYHA	SVB5206	SVB5206I
8	SVB5208HYHA	SVB5208	SVB5208I
10	SVB5210HYHA	SVB5210	SVB5210I
11,5	SVB5211HYHA	SVB5211	SVB5211I
13	SVB5213HYHA	SVB5213	SVB5213I

SHAPEONE S1B

OTTIMA STABILITÀ PRIMARIA

ANCHE IN OSSO D4



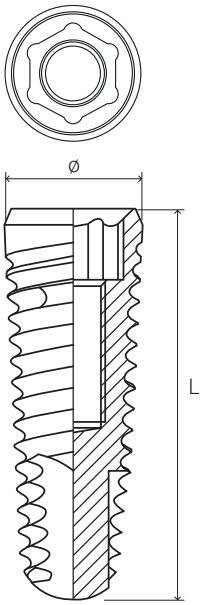

SHAPEONE BIC

Ti

147 €

ESAGONO INTERNO **2,5**
PIATTAFORMA **3,5**
FILETTO INTERNO **1/72**

Ø 3,7

L	NECK
8	S1B3808C
10	S1B3810C
11,5	S1B3811C
13	S1B3813C
16	S1B3816C

Ø 4,1

L	NECK
6	S1B4106C
8	S1B4108C
10	S1B4110C
11,5	S1B4111C
13	S1B4113C
16	S1B4116C

Ø 4,7

L	NECK
6	S1B4706C
8	S1B4708C
10	S1B4710C
11,5	S1B4711C
13	S1B4713C
16	S1B4716C

COMPONENTI PROTESICHE

iMAX NHSI VOLUTION SVB SHAPEONE S1B

ESAGONO INTERNO 2,1
Ø 3,3

ESAGONO INTERNO 2,5
Ø 3,7-4,1-4,7-5,2

GESTIONE DEI TESSUTI MOLLI

VITI CHIRURGICHE

Disponibili come ricambi. S1BNCS/S1BCS inclusa nell'impianto

ø	filetto	⬢	⬢
3,5	1/72	S1BNCS	S1BCS
5	1/72	S1BNCSL	S1BCSL

Ti — *16 €*



VITI PROTESICHE

S1BRS1

Ti — *16 €*



Per monconi filetto 1/72

S1BRS2

Ti — *16 €*



Per componente Mua filetto 1/72

S1BDTRS

Ti — *16 €*



Lunga per transfer filetto 1/72

S1BRS1T6

Ti — *16 €*



Vite protesica torx

VITI DI GUARIGIONE

ø	H	⬢	⬢
3,5	3	S1BN3530HC	S1B3530HC
3,5	4,5	S1BN3545HC	S1B3545HC
3,5	6	S1BN3560HC	S1B3560HC
5	3		S1B5030HC
5	4,5		S1B5045HC
5	6		S1B5060HC

Ti — *26 €*




VITI DI GUARIGIONE PROFILO SVASATO

ø	H	⬢	⬢
3,5	1	S1BN3510HCC	
3,5	3	S1BN3530HCC	S1B3530HCC
3,5	4,5	S1BN3545HCC	S1B3545HCC
3,5	6	S1BN3560HCC	S1B3560HCC
5	3		S1B5030HCC
5	4,5		S1B5045HCC
5	6		S1B5060HCC
6	3		S1B6030HCC
6	4,5		S1B6045HCC

Ti — *26 €*




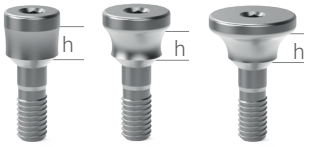

IMPRONTA

ANALOGO

	S1BNIA	S1BIA
Ti		22 €



TRASFERITORE DA IMPRONTA INDIRETTA

ø		
3,5	S1BN135ITC	S1B135ITC
5		S1B150ITC
Ti POM		68 €

Cappetta di ritenzione e vite S1BRS1 incluse



CAPPETTA DI RITENZIONE

	ITC
POM	21 €



MONCONE MULTIFUNZIONE

ø		
3,5	S1BN1A35	
5		S1B1A50
Ti	*S1BRS1 inclusa*	58 €

S1BN1A35 e **S1B1A50** possono essere utilizzati anche come transfer da impronta diretta, con l'acquisto aggiuntivo della vite specifica **S1BDTRS**



MONCONE MULTIFUNZIONE PROFILO SVASATO


ø		
3,5	S1BN1M35	
5		S1B1M50
Ti	*S1BRS1 inclusa*	58 €

S1BN1M35 e **S1B1M50** possono essere utilizzati anche come transfer da impronta diretta, con l'acquisto aggiuntivo della vite specifica **S1BDTRS**



TRANSFER DA IMPRONTA DIRETTA

ø		
3,5	S1BNDT35	S1BDT35
5		S1BDT50
Ti	*S1BDTRS inclusa*	*37 €*




ø		
5	S1BNDT403	S1BDT503
Ti		*47 €*




A 3 componenti per impianti disparalleli

MONCONI DRITTI PROVVISORI

ø		
3,5	S1BN135PR	
3,5	S1BN135P	
4		S1B140PR
4		S1B140P
Ti	*S1BRS1 inclusa*	*47 €*



ø		
3,5	S1BN135PP	
4		S1B140PP
PEEK	*S1BRS1 inclusa*	*58 €*



PROTESI DEFINITIVA

MONCONI DRITTI DEFINITIVI

FRICTION FIT

ø		
3,5	S1BN135FF	S1B135F
5		S1B150F
Ti	*S1BRS1 inclusa*	*68 €*




FRICTION FIT SENZA PROFILO DI EMERGENZA

ø	
4,5	S1B145FS
5,5	S1B155FS
Ti	*S1BRS1 inclusa* *68 €*



ANATOMICO FRICTION FIT

ø	H		
4	1	S1BN1140F	
4	3	S1BN1340F	
4,5	1		S1B1145F
4,5	3		S1B1345F
Ti	*S1BRS1 inclusa*		*68 €*




MONCONI DRITTI DEFINITIVI

ANATOMICO SENZA FRICTION FIT

ø	H		
4	1	S1BN1140	
4	3	S1BN1340	
4,5	1		S1B1145
4,5	3		S1B1345

Ti *S1BRS1 inclusa* *58 €*



PER TECNICA SALDATA

		S1BN1TS	S1B1TS

Ti *S1BRS1 inclusa* *58 €*



MONCONI ANGOLATI

FRICTION FIT

ø		
4,5	20°	S1B250F

Ti *S1BRS1 inclusa* *79 €*



FRICTION FIT SENZA PROFILO DI EMERGENZA

ø		
4,5	20°	S1B245FS

Ti *S1BRS1 inclusa* *79 €*




MONCONI ANGOLATI DEFINITIVI

ANATOMICO SENZA FRICTION FIT

ø		H		
4	15°	1	S1BN211540	
4	15°	3	S1BN231540	
4	25°	1	S1BN212540	
4	25°	3	S1BN232540	
4,5	15°	1		S1B211545
4,5	15°	3		S1B231545
4,5	25°	1		S1B212545
4,5	25°	3		S1B232545

Ti *S1BRS1 inclusa* *68 €*

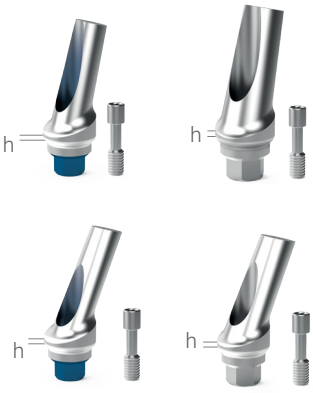


MONCONI ANGOLATI DEFINITIVI

ANATOMICO CON FRICTION FIT

ø		H		
4	15°	1	S1BN211540F	
4	15°	3	S1BN231540F	
4	25°	1	S1BN212540F	
4	25°	3	S1BN232540F	
4,5	15°	1		S1B211545F
4,5	15°	3		S1B231545F
4,5	25°	1		S1B212545F
4,5	25°	3		S1B232545F


Ti *S1BRS1 inclusa* *79 €*

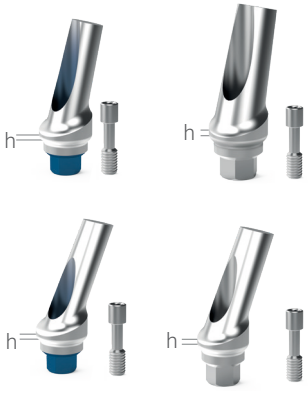

MONCONI CALCINABILI

ø			
3,5		S1BN3PCR35	
3,5		S1BN3PC35	
4,5			S1B3PCR45
4,5			S1B3PC45

POM *S1BRS1 inclusa* *30 €*



ø			
3,5		S1BN3PTC45	
4,5			S1B3PTC45

calcinabile POM - base Ti *S1BRS1 inclusa* *79 €*




BASI DA INCOLLAGGIO

LIBRERIE DIGITALI DISPONIBILI

ROTANTE CON PROFILO DI EMERGENZA

ø			
3,5		S1BN135R	
4,5			S1B140R


Ti *S1BRS1 inclusa* *58 €*



ROTANTE SENZA PROFILO DI EMERGENZA

ø			
3,5		S1BN135RS	
4,5			S1B140RS

Ti *S1BRS1 inclusa* *58 €*




BASI DA INCOLLAGGIO

LIBRERIE DIGITALI DISPONIBILI

FRICTION FIT CON PROFILO DI EMERGENZA

ø		
3,5	S1BN135F	
4,5		S1B140F

Ti — *S1BRS1 inclusa* — *68 €*



FRICTION FIT SENZA PROFILO DI EMERGENZA

ø		
3,5	S1BN135FS	
4,5		S1B140FS


Ti — *S1BRS1 inclusa* — *68 €*



MONCONI A SPALLA

H		
1	S1BN41	S1B41
2	S1BN42	S1B42
3	S1BN43	S1B43
4	S1BN44	S1B44
5	S1BN45	S1B45
6	S1BN46	S1B46

Ti — *Montatore incluso*
Stringere con chiave HDH20 — *58 €*



H			
0/2	18°	S1BN518	S1B518
0/2	30°	S1BN532	S1B532
2/4	30°		S1B534


Ti — *Montatore e S1BRS2 inclusi* — *89 €*



MONCONI A SFERA

ø	H		
4	1	S1BN61	
4	2	S1BN62	
4	3	S1BN63	
4	4	S1BN64	
4	5	S1BN65	
	1		S1B61
	2		S1B62
	3		S1B63
	4		S1B64
	5		S1B65

Ti — *CAH e CALT inclusi* — *47 €*



Trattamento TIN nella parte gialla.
Serrare con cacciavite **MDS o MDL** (pagina 24).

GHIERA CONTENITIVA

CAH	
Ti	16 €




CUFFIA DI RITENZIONE

CALT	
PA	8 €



IRETOR

H		
0	S1BN80	S1B80
1	S1BN81	S1B81
2,5	S1BN825	S1B825
3,5	S1BN835	S1B835
4,5	S1BN845	S1B845
6,5	S1BN865	S1B865
Ti		100 €





Trattamento TIN nella parte gialla. Serrare con chiave **8393** (pagina 51).
Contenitore e cappette non inclusi.

PRE-MILLED

	S1BNPM14	S1BPM14
FRICTION FIT	S1BNPMF4	S1BPMF14
Ti	*S1BRS1 inclusa*	60 €





COMPONENTI PER FLUSSO DIGITALE

Librerie implantari disponibili sul sito https://iess.dental/download/download-matematiche-cad/

ANALOGO DIGITALE

	S1BNDIA	S1BDIA
Ti		22 €





SCAN ABUTMENT

standard	S1BNSA	S1BSA
lungo	S1BNSAL	S1BSAL
Ti	*S1BRS1 inclusa*	58 €





T-BASE

NON ROTANTE

ø	spalla	cuff		
3,4	0,4	0		S1B00DCTB
3,7	0,4	0,8	S1BN11DCTB	
3,7	0,4	0,5		S1B11DCTB
3,7	0,4	1,8	S1BN12DCTB	S1B12DCTB
3,7	0,4	2,8	S1BN14DCTB	
4,5	0,8	1,8	S1BN12DCTB50	S1B12DCTB50
4,5	0,8	2,8	S1BN14DCTB50	
5,7	1,2	1,8		S1B14DCTB
5,7	1,2	2,8		S1B14DCTB50

Ti *S1BRS1 inclusa* *79 €*



ø	spalla	cuff		
3,7	0,5	0,2	S1BN1DTB	S1B1DTB

Ti *S1BRS1 inclusa* *68 €*



	CEREC		S1BN1DTBC	S1B1DTBC

Ti *S1BRS1 inclusa* *68 €*



ROTANTE

ø	spalla	cuff		
3,4	0,4	0		S1B00DCTBR
3,7	0,4	0,8	S1BN11DCTBR	
3,7	0,4	0,5		S1B11DCTBR
3,7	0,4	1,8	S1BN12DCTBR	S1B12DCTBR
3,7	0,4	2,8	S1BN14DCTBR	
4,5	0,8	1,8	S1BN12DCTB50R	S1B12DCTBR50
4,5	0,8	2,8	S1BN14DCTB50R	
5,7	1,2	1,8		S1B14DCTB
5,7	1,2	2,8		S1B14DCTBR50

Ti *S1BRS1 inclusa* *79 €*



ø	spalla	cuff		
3,7	0,5	0,2	S1BN1DTBR	S1B1DTBR

Ti *S1BRS1 inclusa* *68 €*



	CEREC		S1BN1DTBCR	S1B1DTBCR

Ti *S1BRS1 inclusa* *68 €*



FORO INCLINATO SU RICHIESTA

S1BRS1T6


Ti *16 €*




HANDY HNDC

OTTIMA STABILITÀ PRIMARIA


ANCHE IN OSSO D4



INTEGRALE

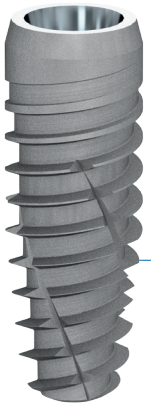

spira doppia
passo largo 0,9

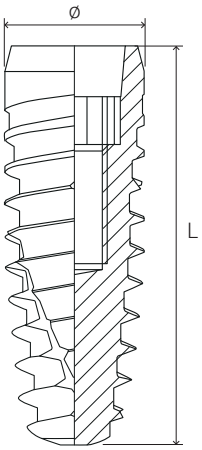

HANDY HNDC

Ti *163 €*

CONNESSIONE **CONOMETRICA 2,1**
PIATTAFORMA **NARROW**
FILETTO INTERNO **1/72**

Ø 3,3

L	INTEGRALE
10	HNDC3310
11,5	HNDC3311
13	HNDC3313
16	HNDC3316

Ø 3,7

L	INTEGRALE
6,5	HNDC3706
8	HNDC3708
10	HNDC3710
11,5	HNDC3711
13	HNDC3713
16	HNDC3716

Ø 4,1

L	INTEGRALE
6,5	HNDC4106
8	HNDC4108
10	HNDC4110
11,5	HNDC4111
13	HNDC4113
16	HNDC4116

Ø 4,7

L	INTEGRALE
6,5	HNDC4706
8	HNDC4708
10	HNDC4710
11,5	HNDC4711
13	HNDC4713
16	HNDC4716


Ø 5,2

L	INTEGRALE
6,5	HNDC5206
8	HNDC5208
10	HNDC5210
11,5	HNDC5211

iMAX NHSIC

IMPIANTO UNIVERSALE PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI OSSO



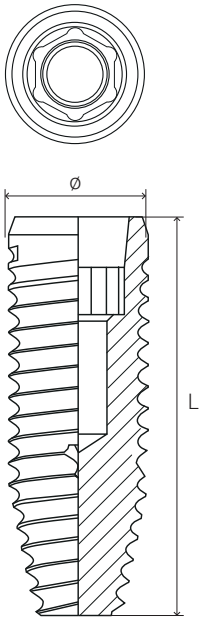

iMAX NHSIC

Ti

163 €

CONNESSIONE **CONOMETRICA 2,1**
PIATTAFORMA **NARROW**
FILETTO INTERNO **1/72**

Ø 3,3

L	NECK
10	NHSIC3310C
11,5	NHSIC3311C
13	NHSIC3313C
16	NHSIC3316C

Ø 3,7

L	NECK
8	NHSIC3708C
10	NHSIC3710C
11,5	NHSIC3711C
13	NHSIC3713C
16	NHSIC3716C

Ø 4,1

L	NECK
6,5	NHSIC4106C
8	NHSIC4108C
10	NHSIC4110C
11,5	NHSIC4111C
13	NHSIC4113C
16	NHSIC4116C

Ø 4,7

L	NECK
6,5	NHSIC4706C
8	NHSIC4708C
10	NHSIC4710C
11,5	NHSIC4711C
13	NHSIC4713C

Ø 5,2

L	NECK
6,5	NHSIC5206C
8	NHSIC5208C
10	NHSIC5210C
11,5	NHSIC5211C
13	NHSIC5213C

COMPONENTI PROTESICHE

CONNESSIONE CONOMETRICA 2,1
Ø 3,3-3,7-4,1-4,7-5,2

■ HANDY HNDC ■ iMAX NHSIC

GESTIONE DEI TESSUTI MOLLI

VITI CHIRURGICHE

Inclusa nell'impianto
Disponibili come ricambi.

		NHSICNCS
Ti		*16 €*



ø	H	
4	3	NHSICN4030HC
4	4,5	NHSICN4045HC
4	6	NHSICN4060HC
Ti	*S1BRS1 inclusa*	*32 €*



Vite S1BRS1 inclusa

VITI PROTESICHE

S1BRS1	
Ti	*16 €*



Per monconi filetto 1/72

S1BRS2	
Ti	*16 €*



Per componente Mua filetto 1/72

S1BDTRS	
Ti	*16 €*



Lunga per transfer filetto 1/72

S1BRS1T6	
Ti	*16 €*



Vite protesica torx

IMPRONTA

ANALOGO

ø	
4	NHSICNIA
Ti	*27 €*



ANALOGO PER CHIRURGIA GUIDATA


ø		
4	corto	NHSICNIAS
Ti		*27 €*



TRANSFER DA IMPRONTA DIRETTA

ø	H	
4	1	NHSICNDT140
4	2	NHSICNDT240
4	4	NHSICNDT440


Ti *S1BDTRS inclusa* *47 €*



MONCONI PROVVISORI

ø	H	
4	1	NHSICN1140PP
4	2	NHSICN1240PP
4	4	NHSICN1440PP

PEEK *S1BRS1 inclusa* *53 €*




PROTESI DEFINITIVA

MONCONI DRITTI

ø	H		
4	1		NHSICN1140
4	2		NHSICN1240
4	4		NHSICN1440

Ti *S1BRS1 inclusa* *89 €*




BASI PER INCOLLAGGIO*

** fino ad esaurimento scorte*

ø	H		
4	1		NHSICN1140SB
4	2		NHSICN1240SB
4	4		NHSICN1440SB
4	1		NHSICN1140RSB
4	2		NHSICN1240RSB
4	4		NHSICN1440RSB


Ti *S1BRS1 inclusa* *79 €*



MONCONI ANGOLATI

ø	H		
4	1	15°	NHSICN211540
4	2	15°	NHSICN221540
4	4	15°	NHSICN241540
4	1	25°	NHSICN212540
4	2	25°	NHSICN222540
4	4	25°	NHSICN242540

Ti *S1BRS1 inclusa* *89 €*



MONCONI A SPALLA

ø	H	
4	1	NHSICN41
4	2	NHSICN42
4	4	NHSICN44

Montatore incluso
Stringere con chiave HDH20

Ti — *58 €*



ø	H		
4,1	0/2	18°	NHSICN518
4,1	0/2	30°	NHSICN532
4,1	2/4	30°	NHSICN534

Montatore e S1BRS2 inclusi

Ti — *95 €*



MONCONI A SFERA

ø	H	
4	1	NHSICN61
4	2	NHSICN62
4	4	NHSICN64

CAH e CAT inclusi

Ti — *58 €*



Trattamento TIN nella parte gialla.
Serrare con cacciavite **MDS o MDL** (pagina 24)

GHIERA CONTENITIVA

CAH		
Ti	*16 €*	



CUFFIA DI RITENZIONE


CALT		
PA	*8 €*	



IRETOR

H	
0	NHSICN80
1	NHSICN81
2	NHSICN825
3	NHSICN835
4	NHSICN845
6	NHSICN865

Ti — *100 €*



Trattamento TIN nella parte gialla.
Serrare con chiave **8393** (pagina 51).
Contenitore e cappette non inclusi.

COMPONENTI PER FLUSSO DIGITALE

Librerie implantari disponibili sul sito https://iess.dental/download/download-matematiche-cad/

ANALOGO

ø	
4	NHSICNDIA


Ti — 27 €



SCAN ABUTMENT

standard	NHSICNSA
lungo	NHSICNSAL

Ti — *S1BRS1 inclusa* — 68 €



T-BASE

H		
1		NHSICN11DTB
2		NHSICN12DTB
4		NHSICN14DTB
1		NHSICN11DTBR
2		NHSICN12DTBR
4		NHSICN14DTBR

Ti — *S1BRS1 inclusa* — 79 €



FORO INCLINATO SU RICHIESTA

S1BRS1T6


Ti — *16 €*



LINK

ø	H	⬢	⬢
3,5	3	NHSICNL1	
3,5	4	NHSICNL2	
3,5	5	NHSICNL3	
4,1	3		NHSICNL4
4,1	4		NHSICNL5
4,1	5		NHSICNL6
4,1	6		NHSICNL7

Ti — 89 €



PRE-MILLED

ø	H	
14	1	NHSICNPM14

Ti — *S1BRS1 inclusa* — 60 €



iMAX NHSE

IMPIANTO UNIVERSALE PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI OSSO



iMAX NHSE HYHA — Ti — *179 €*

iMAX NHSE C — Ti — *147 €*

ESAGONO ESTERNO **2,4**
PIATTAFORMA **3,5**
FILETTO INTERNO **M1,6**

ESAGONO ESTERNO **2,7**
PIATTAFORMA **4,1**
FILETTO INTERNO **M2**

Ø 3,3

L	IBRIDO	NECK
10	NHSE3310HYHA	NHSE3310C
11,5	NHSE3311HYHA	NHSE3311C
13	NHSE3313HYHA	NHSE3313C
16	NHSE3316HYHA	NHSE3316C

Ø 3,7

L	IBRIDO	NECK*
6,5	NHSE3706HYHA	NHSI3706C
8	NHSE3708HYHA	NHSI3708C
10	NHSE3710HYHA	NHSI3710C
11,5	NHSE3711HYHA	NHSI3711C
13	NHSE3713HYHA	NHSI3713C
16	NHSE3716HYHA	NHSI3716C

Ø 4,1

L	IBRIDO	NECK*
6,5	NHSE4106HYHA	NHSI4106C
8	NHSE4108HYHA	NHSI4108C
10	NHSE4110HYHA	NHSI4110C
11,5	NHSE4111HYHA	NHSI4111C
13	NHSE4113HYHA	NHSI4113C
16	NHSE4116HYHA	NHSI4116C

Ø 4,7

L	IBRIDO	NECK*
6,5	NHSE4706HYHA	NHSI4706C
8	NHSE4708HYHA	NHSI4708C
10	NHSE4710HYHA	NHSI4710C
11,5	NHSE4711HYHA	NHSI4711C
13	NHSE4713HYHA	NHSI4713C
16	NHSE4716HYHA	NHSI4716C

Ø 5,2

L	IBRIDO	NECK*
6,5	NHSE5206HYHA	NHSI5206C
8	NHSE5208HYHA	NHSI5208C
10	NHSE5210HYHA	NHSI5210C
11,5	NHSE5211HYHA	NHSI5211C
13	NHSE5213HYHA	NHSI5213C

* fino ad esaurimento scorte

COMPONENTI PROTESICHE

iMAX NHSE

ESAGONO ESTERNO 2,4
Ø 3,3

ESAGONO ESTERNO 2,7
Ø 3,7-4,1-4,7-5,2

GESTIONE DEI TESSUTI MOLLI

VITI CHIRURGICHE

Disponibili come ricambi
Inclusa nell'impianto

ø	filetto	⬢	⬢
3,5	M1,6	S1EHNCS	
4,1	M2		S1EHCS
Ti			*16 €*



VITI PROTESICHE

filetto	⬢	⬢
M1,6	S1EHNRS1	
M2		S1EHRS1
Ti		*16 €*



Per monconi

filetto	⬢	⬢
M1,6	S1EHNRS2	
M2		S1EHRS2
Ti		*16 €*



Per monconi

filetto	⬢	⬢
M1,6	S1EHNDTRS	
M2		S1EHDTRS
Ti		*16 €*



Lunga per transfer


filetto	⬢	⬢
M1,6	S1EHNRS1T6	
M2		S1EHRS1T6
Ti		*16 €*



Vite a torx per digitale

VITI DI GUARIGIONE


ø	H	⬢	⬢
3,5	3	S1EHN3530HC	
3,5	4,5	S1EHN3545HC	
3,5	6	S1EHN3560HC	
4,1	3		S1EH4130HC
4,1	5		S1EH4145HC
4,1	6		S1EH4160HC
5	3		S1EH5030HC
5	5		S1EH5045HC
5	6		S1EH5060HC
Ti			*26 €*



IMPRONTA

ANALOGO

	S1EHNIA	S1EHIA
Ti		*22 €*



TRANSFER DA IMPRONTA DIRETTA

ø		
3,5	S1EHNDT35	
S1EHNDTRS inclusa		
4,1		S1EHDT41
5		S1EHDT50
S1EHDTRS inclusa		
Ti		*37 €*



MONCONE MULTIFUNZIONE

ø		
3,5	S1EHN1A35	
5		S1EH1A50
S1EHRS1 inclusa		*68 €*
Ti		



S1EHN1A35 e S1EH1A50 possono essere utilizzati come transfer da impronta diretta, con l'acquisto aggiuntivo della vite specifica S1EHNDTRS o S1EHDTRS

MONCONI PROVVISORI

ø		
3,5	S1EHN135PR	
3,5	S1EHN135P	
4,1		S1EH141PR
4,1		S1EH141P
Ti	*S1EHNRS1 - S1EHRS1 incluse*	*47 €*



PROTESI DEFINITIVA

MONCONI DRITTI DEFINITIVI

ø			
4		S1EHN140	
S1EHNRS1 inclusa			
5			S1EH150
S1EHRS1 inclusa			
Ti			*68 €*



ANATOMICO

ø	H			
4	1		S1EHN1135	
4	3		S1EHN1335	
S1EHNRS1 inclusa				
4,1	1			S1EH1141
4,1	3			S1EH1341
S1EHRS1 inclusa				
Ti				*68 €*




PER TECNICA SALDATA

		S1EHN1TS	
S1EHNRS1 inclusa			
			S1EH1TS
S1EHRS1 inclusa			
Ti			*58 €*




BASI DA INCOLLAGGIO

ø		
4	S1EHN135	
S1EHNRS1 inclusa		
4,1		S1EH141
S1EHRS1 inclusa		
Ti		*68 €*

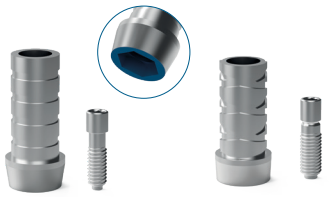


ø		
4	S1EHN135R	
S1EHNRS1 inclusa		
4,1		S1EH141R
S1EHRS1 inclusa		
Ti		*58 €*

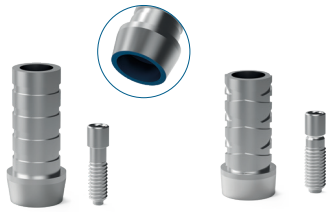

MONCONI ANGOLATI DEFINITIVI

ø	H			
4	1	15°	S1EHN211540	S1EH211550
4	3	15°	S1EHN231540	S1EH231550
4	1	25°	S1EHN212540	S1EH212550
4	3	25°	S1EHN232540	S1EH232550
		inclusa	*S1EHNRS2*	*S1EHRS2*
Ti				*79 €*

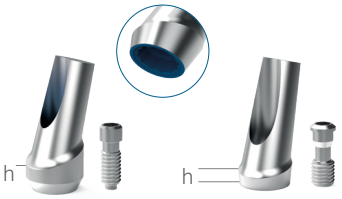


MONCONI CALCINABILI

ø		
3,5	S1EHN3PC35	
4	S1EHN3PCR35	
S1EHNRS1 inclusa		
4,1		S1EH3PC41
4,1		S1EH3PCR41
S1EHRS1 inclusa		
POM		*30 €*



MONCONI A SPALLA


ø	H		
3,5	1	S1EHN41	
3,5	2	S1EHN42	
3,5	3	S1EHN43	
3,5	4	S1EHN44	
3,5	5	S1EHN45	
4,1	1		S1EH41
4,1	2		S1EH42
4,1	3		S1EH43
4,1	4		S1EH44
4,1	5		S1EH45
Ti	*Montatore incluso* *Stringere con chiave HDH20*		*58 €*

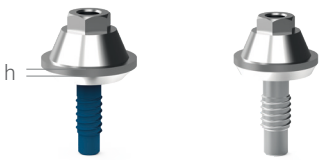

MONCONI A SPALLA

ø	H			
3,5	0/2	18°	S1EHN518	
3,5	0/2	30°	S1EHN532	
4,1	0/2	18°		S1EH518
4,1	0/2	30°		S1EH532
4,1	2/4	30°		S1EH534
		inclusa	*S1EHNRS2*	*S1EHRS2*


Ti *Montatore incluso* *89 €*

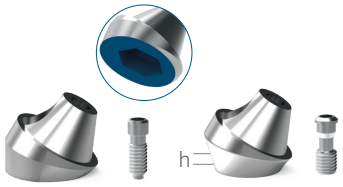

MONCONI A SFERA

ø	H		
3,5	1	S1EHN61	
3,5	2	S1EHN62	
3,5	3	S1EHN63	
3,5	4	S1EHN64	
4,1	1		S1EH61
4,1	2		S1EH62
4,1	3		S1EH63
4,1	4		S1EH64

Ti *CAH e CAT inclusi* *47 €*

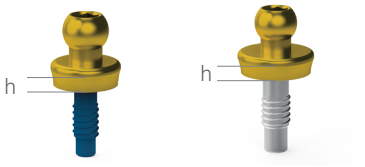

Trattamento TIN nella parte gialla.
Serrare con cacciavite **MDS o MDL** (pagina 24)

GHIERA CONTENITIVA

CAH

Ti *16 €*



CUFFIA DI RITENZIONE

CALT

PA *8 €*



IRETOR

H		
0	S1EHN80	S1EH80
1	S1EHN81	S1EH81
2,5	S1EHN825	S1EH825
3,5	S1EHN835	S1EH835
4,5	S1EHN845	S1EH845
6,5	S1EHN865	S1EH865

Ti *100 €*



Trattamento TIN nella parte gialla.
Serrare con chiave **8393** (pagina 51).
Contenitore e cappette non inclusi.

COMPONENTI PER FLUSSO DIGITALE

Librerie implantari disponibili sul sito https://iess.dental/download/download-matematiche-cad/

ANALOGO DIGITALE

		S1EHNDIA	S1EHDIA
Ti			*22 €*



SCAN ABUTMENT

		S1EHNSA	S1EHSA
	inclusa	*S1EHNRS1*	*S1EHRS1*
Ti			*58 €*



T-BASE

		S1EHN1DTB	S1EH1DTB
		S1EHN1DTBR	S1EH1DTBR
	inclusa	*S1EHNRS1*	*S1EHRS1*
Ti			*74 €*

Colorazione interna nella parte protesica



FORO INCLINATO SU RICHIESTA

	S1EHNRS1T6	S1EHRS1T6
Ti		*16 €*



ACCESSORI IRETOR

Componenti per i monconi a sfera delle linee SVB, NHSI, S1B, NHSE e NHSIC

ANALOGO

			144ATP
Inox	PA	2 pcs	*26 €*




TRANSFER

			044CAIP
Inox	PA	2 pcs	*26 €*



INSERITORE/ESTRATTORE

			488EIP
Inox	PA		*47 €*

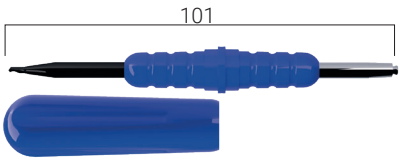

Per inserire e rimuovere le cappette del sistema iRetor. Autoclavabile.

AVVITATORE

			8393
Inox			*100 €*



CONTENITORE IN TITANIO

			141CTP
Ti		2 pz	*29 €*




CAPPETTE PER LABORATORIO

			143CPN
PA		2 pz	*32 €*



SET CAPPETTE

		con pin	192CPC
		senza pin	192CPS
Ti	PA	EVA	*39 €*

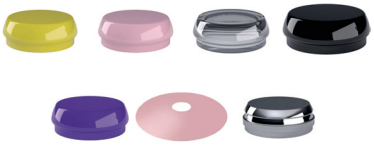



CAPPETTE PARALLELE


Kg	PIN	
0,7	extra soft	142CPPG
0,9	soft	142CPPR
1,5	standard	142CPPT
1,8	strong	142CPPV
PA	4 pz	*31 €*

CAPPETTE DISPARALLELE

Kg	PIN	
0,6	extra soft	143CPG
0,8	soft	143CPR
1	standard	143CPT
1,5	strong	143CPV
PA	4 pz	*31 €*

COMPONENTI MUA

Componenti per i monconi a spalla delle linee SVB, NHSI, HNDC, S1B, NHSE e NHSIC

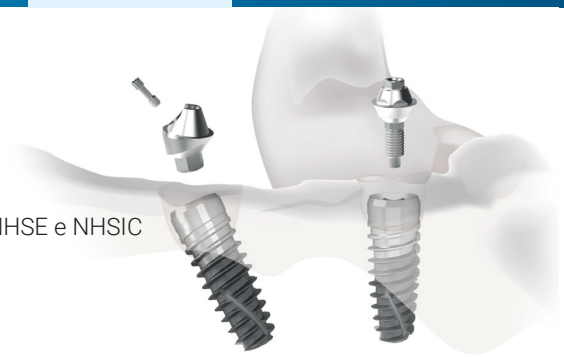

VITI DI RITENZIONE

S1BRS3

Ti 16 €



Per monconi filetto M1,4

S1BDTRSA

Ti 16 €



Vite di ritenzione per transfer MUA filetto M1,4

CUFFIE DI GUARIGIONE

S1BHCSRA

inclusa S1BRS3

Ti 26 €



S1BHCSRAA

inclusa S1BRS3

POM 26 €



ANALOGO

S1BIASRA

Ti 22 €



TRANSFER DA IMPRONTA INDIRETTA

S1BITCSRA

Ti *inclusa S1BRS3* 58 €



TRANSFER DA IMPRONTA DIRETTA

S1BDTCSRA

Ti *inclusa S1BDTRSA* 37 €



MONCONE DRITTO PROVVISORIO

S1BPTTA

Ti *inclusa S1BRS3* 58 €



MONCONE DRITTO DEFINITIVO

S1BTTA

Ti *inclusa S1BRS3* 58 €



MONCONE CALCINABILE

		S1BPCC
POM	*inclusa S1BRS3*	*30 €*




MONCONE PER TECNICA SALDATA

		S1BTS
Ti	*inclusa S1BRS3*	*58 €*



TORRETTA NON ROTANTE

		S1BTTAE
Ti	*inclusa S1BRS3*	*58 €*



TORRETTA PER MUA PER BARRA FAST BRIDGE

		S1BTTAFB
Ti	*inclusa S1BRS3*	*58 €*



COMPONENTI PER FLUSSO DIGITALE

Librerie implantari disponibili sul sito https://iess.dental/download/download-matematiche-cad/


ANALOGO

		S1BDIASRA
Ti		*22 €*



SCAN ABUTMENT

	standard	S1BSAA
	lungo	S1BSAAL
Ti	*S1BRS3 inclusa*	*58 €*




T-BASE


		S1BTTADTB
Ti	*S1BRS3 inclusa*	*68 €*



IMPIANTI
TISSUE LEVEL

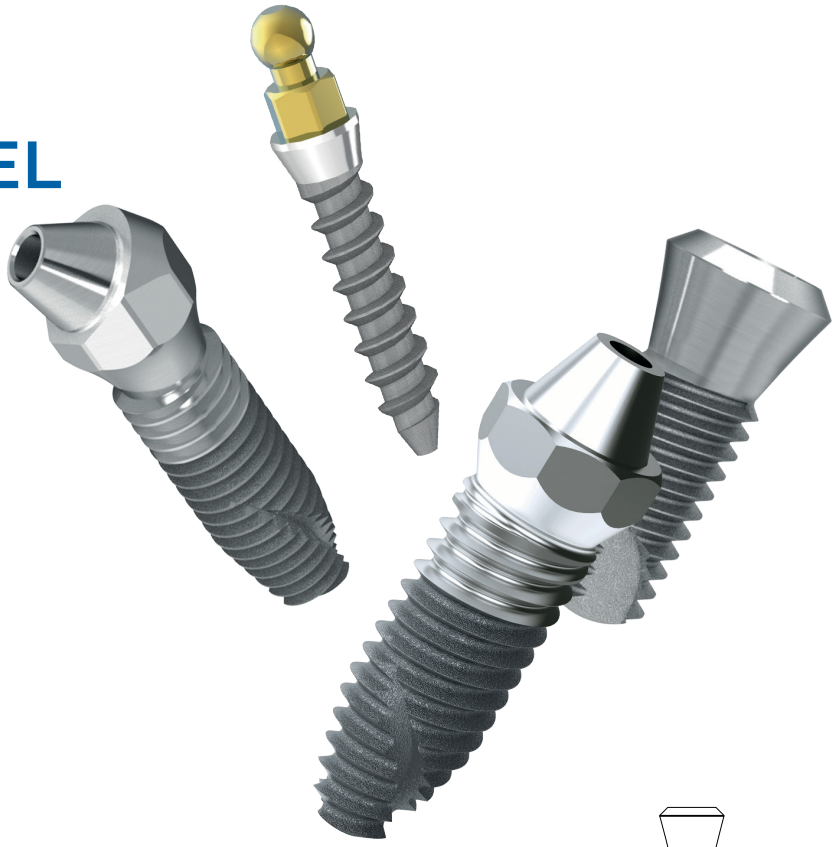


SHAPEONE S1T




- TRANSMUCOSO OTTAGONO INTERNO **ø 3,7 - 4,1 - 4,7**
- TRANSMUCOSO ESAGONO INTERNO **ø 3,7 - 4,1 - 4,7**

iMAXMUA NHSM



ONE PIECE **ø 3,3 - 3,7 - 4,1**

SHAPEMINI SM




MONOSPIRA **ø 2,7**


Gli impianti dentali sono realizzati in titanio per uso medicale in conformità alle normative vigenti

SHAPEONE S1T

OTTIMA STABILITÀ PRIMARIA

ANCHE IN OSSO D4



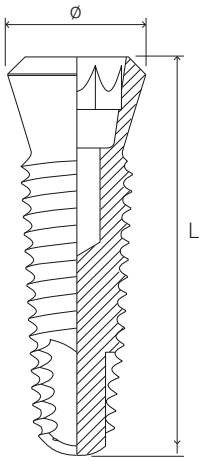

NECK



spira doppia
passo fine 0,6

SHAPEONE TC

Ti

158 €

CONNESSIONE **OTTAGONALE INTERNA 3,1**
PIATTAFORMA **4,8**
FILETTO INTERNO **M2**

Ø 3,7

L	NECK
8	S1T3708
10	S1T3710
11,5	S1T3711
13	S1T3713
16	S1T3716

Ø 4,1

L	NECK
4,5	S1T4104
6,5	S1T4106
8	S1T4108
10	S1T4110
11,5	S1T4111
13	S1T4113
16	S1T4116

Ø 4,7

L	NECK
4,5	S1T4704
6,5	S1T4706
8	S1T4708
10	S1T4710
11,5	S1T4711
13	S1T4713
16	S1T4716

COMPONENTI PROTESICHE

CONNESSIONE
OTTAGONALE INTERNA 3,1
Ø 3,7-4,1-4,7

SHAPEONE S1T

GESTIONE DEI TESSUTI MOLLI

VITI CHIRURGICHE

Disponibili come ricambi.
S1TCS inclusa nell'impianto

ø	H	
4,8	2	S1TCS
4,8	5	S1TCSH

Ti — *16 €*



VITI PROTESICHE

S1TRS1

Ti — *16 €*



Per monconi filetto M2

S1TRS2

Ti — *16 €*



Per monconi filetto M2

S1TDTRS

Ti — *16 €*



Lunga per transfer filetto M2

S1BRS1T6

Ti — *16 €*



Vite a torx per digitale

IMPRONTA

ANALOGO

	S1TIA

Ti — *22 €*



TRANSFER

ø	
5	S1T1A50

Ti — *S1TRS1 inclusa* — *58 €*



Moncone multifunzione. **Transfer da impronta indiretta**
Può essere utilizzato anche come **trasferitore diretto**, con l'acquisto aggiuntivo della vite specifica **S1TDTRS**

PROTESI DEFINITIVA

MONCONI CALCINABILI

ø		
5		S1T3PC50
5		S1T3PCR50

Ti POM — *S1TRS1 inclusa* — *30 €*



MONCONE DRITTO

ø		
4,5		S1T140
Ti	*S1TRS1 inclusa*	*79 €*




MONCONE ANGOLATO

ø		
4,5	20°	S1T240
Ti	*S1TRS2 inclusa*	*89 €*



MONCONI A SFERA

ø	H	
4,5	0	S1T60
4,5	1	S1T61
4,5	2	S1T62
Ti	*CAH e CAT inclusi*	*47 €*



Trattamento TIN nella parte gialla.
Serrare con cacciavite **MDS o MDL** (pagina 24).

GHIERA CONTENITIVA

CAH	
Ti	*16 €*



CUFFIA DI RITENZIONE

CALT	
PA	*8 €*



COMPONENTI PER FLUSSO DIGITALE

Librerie implantari disponibili sul sito https://iess.dental/download/download-matematiche-cad/

ANALOGO

	S1TDIA
Ti	*22 €*



SCAN ABUTMENT

		S1TSA
Ti	*S1TRS1 inclusa*	*58 €*



T-BASE

ø		
5		S1T1DTB
5		S1T1DTBR
Ti	*S1TRS1 inclusa*	*79 €*



FORO INCLINATO SU RICHIESTA

S1TRS1T6	
Ti	*16 €*



SHAPEONE S1TN


OTTIMA STABILITÀ PRIMARIA

ANCHE IN OSSO D4

NECK



spira tripla
passo fine 0,6

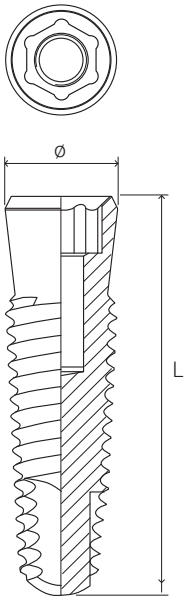

SHAPEONE TN C

Ti

158 €

CONNESSIONE **ESAGONALE INTERNA 2,5**
PIATTAFORMA **3,5**
FILETTO INTERNO **1/72**

Ø 3,7

L	NECK
8	S1TN3708
10	S1TN3710
11,5	S1TN3711
13	S1TN3713
16	S1TN3716

Ø 4,1

L	NECK
4,5	S1TN4104
6,5	S1TN4106
8	S1TN4108
10	S1TN4110
11,5	S1TN4111
13	S1TN4113

COMPONENTI PROTESICHE

CONNESSIONE
ESAGONALE INTERNA 2,5
Ø 3,7-4,1-4,7

SHAPEONE S1TN

GESTIONE DEI TESSUTI MOLLI

VITI PROTESICHE

S1BRS1	
Ti	*16 €*

Per monconi filetto 1/72



S1BDTRS	
Ti	*16 €*

Lunga per transfer filetto 1/72



IMPRONTA

ANALOGO

ø	
3,7	S1TNIA37
4,1	S1TNIA41
4,7	S1TNIA47
Ti	*23 €*



TRANSFER DA IMPRONTA INDIRETTA

ø		
3,5		S1TN1A35
3,7		S1TN1A37
4,1		S1TN1A41
4,7		S1TN1A47
Ti	*S1BRS1 inclusa*	*58 €*




S1TN1A35, **S1TN1A37**, **S1TN1A41** e **S1TN1A47** possono essere utilizzati come transfer da impronta diretta, con l'acquisto aggiuntivo della vite specifica **S1BDTRS**

PROTESI DEFINITIVA

La protesica definitiva SHAPEONE S1TN è compatibile con la protesica dell'impianto IMAX NHSI, VOLUTION SVB, SHAPEONE S1B (pagg. 30-37)

iMAXMUA NHSM

ONE PIECE PER IL CARICO IMMEDIATO

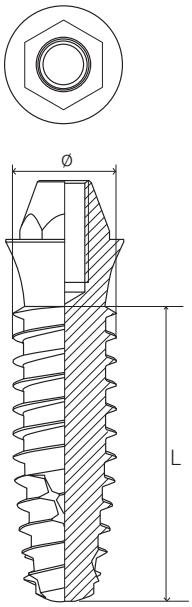

IBRIDO 0°



iMAXMUA NHSM HYHA

Ti 210 €

IBRIDO 18°



iMAXMUA NHSM HYHA 18

Ti 242 €

IBRIDO 30°



iMAXMUA NHSM HYHA 30

Ti 242 €

Mounter NHSMM
incluso

CONNESSIONE **ONE PIECE**
PIATTAFORMA **4,3**
FILETTO INTERNO **1/72**

Ø 3,3 - 0°

L	IBRIDO
4,5	NHSM330402
6,5	NHSM330602
8	NHSM330802
10	NHSM331002
11,5	NHSM331102
13	NHSM331302

Ø 3,7 - 0°

L	IBRIDO
4,5	NHSM370402
6,5	NHSM370602
8	NHSM370802
10	NHSM371002
11,5	NHSM371102
13	NHSM371302

Ø 4,1 - 0°

L	IBRIDO
4,5	NHSM410402
6,5	NHSM410602
8	NHSM410082
10	NHSM411002
11,5	NHSM411102
13	NHSM411302

Ø 3,7 - 18°

L	IBRIDO
11	NHSM371118
13	NHSM371318

Ø 3,7 - 30°

L	IBRIDO
11	NHSM371130
13	NHSM371330
16	NHSM371630

Ø 4,1- 18°

L	IBRIDO
11	NHSM411118
13	NHSM411318

Ø 4,1- 30°

L	IBRIDO
11	NHSM411130
13	NHSM411330
16	NHSM411630

COMPONENTI PROTESICHE

CONNESSIONE
ONE PIECE **Ø 3,7-4,1-4,7**

iMAXMUA NHSM

GESTIONE DEI TESSUTI MOLLI

VITI DI RITENZIONE

NHSMRS1

Ti 16 €



Per monconi filetto 1/72

NHSMDTRS

Ti 16 €



Lunga per transfer filetto 1/72

CUFFIE DI RITENZIONE

NHSMHCSRA

Ti *NHSMRS1 inclusa* 26 €



NHSMHCSRAA

POM *NHSMRS1 inclusa* 26 €



IMPRONTA

ANALOGO

NHSMIASRA

Ti 22 €



TRANSFER DA IMPRONTA INDIRETTA

NHSMITCSRA

Ti *NHSMRS1 inclusa* 58 €



TRANSFER DA IMPRONTA DIRETTA

NHSMDTCSRA


Ti *NHSMDTRS inclusa* 37 €



TORRETTA NON ROTANTE

NHSMTTAE


Ti *inclusa NHSMRS1* 58 €



TORRETTA PER MUA
PER BARRA FAST BRIDGE

NHSMTTAFB


Ti *inclusa NHSMRS1* *58 €*



MONCONE DRITTO
PROVVISORIO

NHSMPTTA

Ti *inclusa NHSMRS1* *58 €*



MONCONE DRITTO
DEFINITIVO

NHSMTTA

Ti *inclusa NHSMRS1* *58 €*



MONCONE
CALCINABILE

NHSMPCC


POM *inclusa NHSMRS1* *30 €*



MONCONE
PER TECNICA SALDATA

NHSMTS

Ti *inclusa NHSMRS1* *58 €*



COMPONENTI PER FLUSSO DIGITALE

Librerie implantari disponibili sul sito https://iess.dental/download/download-matematiche-cad/

ANALOGO

NHSMDIASRA

Ti *22 €*



SCAN ABUTMENT

NHSMSAA


Ti *inclusa NHSMRS1* *58 €*



T-BASE

NHSMTTADTB

Ti *inclusa NHSMRS1* *68 €*



SHAPEMINI SM



SHAPEMINI

Ti 58 €

Ø 2,7

L	IBRIDO
8	SM2708
10	SM2710
11,5	SM2711
13	SM2713
16	SM2716

CONNESSIONE **BALL ATTACHMENT**

PASSO **1,25 mm**

COMPONENTI PROTESICHE

ANALOGO

Ti SMIA 22 €



GHIERA CONTENITIVA

Ti CAH 16 €



CUFFIA DI RITENZIONE

PA CALT 8 €



CAPPETTA TRANSFER

POM SMITC 21 €



MONCONE DRITTO

Ti SMF 30 €



CALCINABILE

POM SMC 30 €





SHAPEMINI

Ti 58 €

Ø 2,7

L	IBRIDO
8	SM2708F
10	SM2710F
11,5	SM2711F
13	SM2713F
16	SM2716F

MONCONE FISSO DA CEMENTAZIONE

PASSO **1,25 mm**

COMPONENTI PROTESICHE

ANALOGO

Ti SMIAF 22 €



CAPPETTA TRANSFER

POM SMITC 21 €



MONCONE DRITTO

Ti SMF 30 €




CALCINABILE

POM SMC 30 €



IMPIANTI **PTERIGOIDEI**

Nei casi di grave atrofia della regione posteriore del mascellare superiore, gli **impianti pterigoidei** rappresentano una valida soluzione tra le opzioni cliniche disponibili.
Grazie alla maggior lunghezza rispetto agli impianti standard, gli impianti pterigoidei possono oltrepassare il tuber e raggiungere la placca pterigoidea, caratterizzata da osso compatto e stabile.

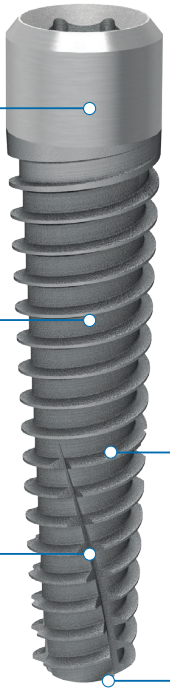

2,5 mm di collo macchinato con **platform switching**
Distribuisce la pressione sulla corticale e ostacola l'infiltrazione batterica

Corpo conico con design ogivale
Elevata capacità di penetrazione

3 tagli apicali elicoidali

Doppia spira pronunciata a profilo tagliente
Maggiore stabilità primaria e proprietà automaschianti

Apice conico con punta arrotondata

VANTAGGI

Osteointegrazione più sicura, grazie alle caratteristiche intrinseche del sito che assicurano elevata stabilità implantare;
Soluzione minimamente invasiva e **tempi di guarigione ridotti,** poiché consente di evitare interventi di rialzo di seno e procedure di innesto;
Ricostruzione completa del settore posteriore senza cantilever protesici, ideale per una distribuzione ottimale dei carichi masticatori.



VOLUTION

VOLUTION SVBC


MISURE DISPONIBILI

H	ø 3,7	H	ø 4,1
18	SVB3818	18	SVB4118
20	SVB3820	20	SVB4120
22	SVB3822	22	SVB4122
24	SVB3824	24	SVB4124

Ti *163 €*

IMPIANTI **ZIGOMATICI**

Nei casi di **grave atrofia mascellare**, l'inserimento di impianti zigomatici rappresenta una **valida alternativa alle complesse procedure di rigenerazione ossea**.

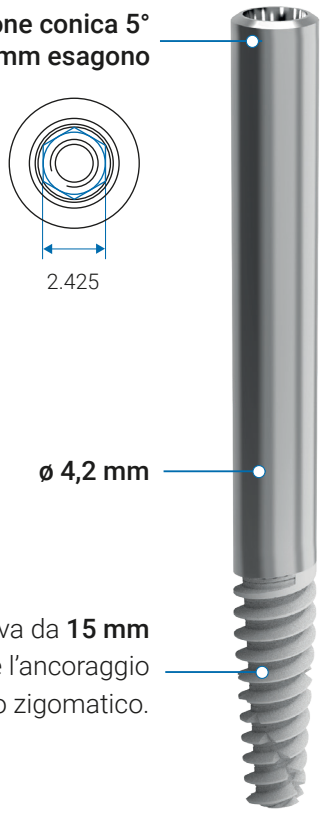

MISURE DISPONIBILI

H	ø 4,1
35	Z4135T
40	Z4140T
45	Z4145T
50	Z4150T
55	Z4155T
60	Z4160T


Ti *280 €*

Componenti protesici dedicati consentono la **correzione dell'asse protesico.**

MONCONE MUA

0/2	18°	NHSIC518
0/2	30°	NHSIC532
2/4	30°	NHSIC534

Ti *105 €*





KIT - PTERIGOIDEI E ZIGOMATICI

ZSK

PPSU SI *2625 €*

TWA4	cricchetto completo
TRT	Estrattore per abutment
THDDL	Cacciavite lungo esagonale da 1,25 mm
LD	Fresa a lancia
CSD37	Countersink ø 3,7
CSD41	Countersink ø 4,1
HDH25L	Connettore lungo per esagono interno 2,5
DEEP PROBE	Sonda di profondità zigomatica
D3338L	Fresa lunga ø 3,3/3,8
D2428L	Fresa lunga ø 2,4/2,8
D2833L	Fresa lunga ø 2,8/3,3

D202530S	Fresa zigomatica ø 2 L.75
D202530L	Fresa zigomatica ø 2 L.95
D2830S	Fresa zigomatica ø 2,8 L.75
D2830L	Fresa zigomatica ø 2,8 L.95
CD41M	Fresa per preparazione della sede ø 4,2 media
CD41G	Fresa per preparazione della sede ø 4,2 grossa
D20L	Fresa lunga ø 2
D2024L	Fresa lunga ø 2/2,4
ZLDS	Fresa lanceata zigomatica L.55
ZLDL	Fresa lanceata zigomatica L.95
IDL25HD	Cacciavite lungo per esagono standard

DIGITALS

Le soluzioni digitali proposte da IESS Group costituiscono un **sistema aperto**, **flessibile** ed **economico** che consente di:

- acquisire un **flusso digitale completo**;
- dotarsi di **tecnologie innovative** e **adattabili** a qualsiasi sistema informatico;
- implementare la propria struttura digitale con **attrezzature** e **strumenti versatili**;
- definire un efficace **flusso di lavoro** studio-laboratorio.



ANALISI **DIGITALE** DEL PAZIENTE

Tutte le tecnologie **per semplificare** la **valutazione** delle diverse opzioni cliniche, **rendere più efficace** la **comunicazione** con il paziente e monitorare nel tempo il trattamento.



CHIRURGIA **GUIDATA**

Una tecnica ormai consolidata che rende **più semplici** gli interventi di inserimento implantare e consente un approccio clinico **protesicamente guidato** grazie a **software di pianificazione e kit** e **strumenti** per l'esecuzione dell'intervento.




PROTESI **PERSONALIZZATA**

Soluzioni molteplici per ogni tipologia di flusso di lavoro tra odontoiatra e odontotecnico, che hanno a disposizione:

- **stampanti 3D**, per produzione in **laboratorio** o **sistemi chairside**
- **Performa**, il centro di fresaggio **CAD CAM** attivo dal 2015
- **Griglie personalizzate** per chirurgia avanzata



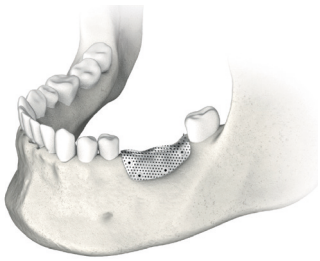

CHIRURGIA **GUIDATA**

KIT DI CHIRURGIA GUIDATA

PPSU | SI | GSK | *2.625 €*






BP	bone profile chirurgia guidata
GD202406	fresa ø 2,0/2,4 x 6,5 mm
GD202408	fresa ø 2,0/2,4 x 8 mm
GD202410	fresa ø 2,0/2,4 x 10 mm
GD202411	fresa ø 2,0/2,4 x 11,5 mm
GD202413	fresa ø 2,0/2,4 x 13 mm
GD202416	fresa ø 2,0/2,4 x 16 mm
GD242806	fresa ø 2,4/2,8 x 6,5 mm
GD242808	fresa ø 2,4/2,8 x 8 mm
GD242810	fresa ø 2,4/2,8 x 10 mm
GD242811	fresa ø 2,4/2,8 x 11,5 mm
GD242813	fresa ø 2,4/2,8 x 13 mm
GD242816	fresa ø 2,4/2,8 x 16 mm
GD283306	fresa ø 2,8/3,3 x 6,5 mm
GD283308	fresa ø 2,8/3,3 x 8 mm
GD283310	fresa ø 2,8/3,3 x 10 mm
GD283311	fresa ø 2,8/3,3 x 11,5 mm
GD283313	fresa ø 2,8/3,3 x 13 mm
GD283316	fresa ø 2,8/3,3 x 16 mm
GD333806	fresa ø 3,3/3,8 x 6,5 mm
GD333808	fresa ø 3,3/3,8 x 8 mm
GD333810	fresa ø 3,3/3,8 x 10 mm
GD333811	fresa ø 3,3/3,8 x 11,5 mm
GD333813	fresa ø 3,3/3,8 x 13 mm
GD333816	fresa ø 3,3/3,8 x 16 mm
GD384406	fresa ø 3,8/4,4 x 6,5 mm
GD384408	fresa ø 3,8/4,4 x 8 mm
GD384410	fresa ø 3,8/4,4 x 10 mm
GD384411	fresa ø 3,8/4,4 x 11,5 mm
GD384413	fresa ø 3,8/4,4 x 13 mm
GD384416	fresa ø 3,8/4,4 x 16 mm
GDCSD33	fresa svasatrice ø 3,3
GDCSD37	fresa svasatrice ø 3,7
GDCSD41	fresa svasatrice ø 4,1
GDCSD47	fresa svasatrice ø 4,7
GDTAPS1B37	maschiatore S1B ø 3,7
GDTAPS1B41	maschiatore S1B ø 4,1
GDTAPS1B47	maschiatore S1B ø 4,7
GDTAPIMAX33	maschiatore iMAX ø 3,3
GDTAPIMAX37	maschiatore iMAX ø 3,7
GDTAPIMAX41	maschiatore iMAX ø 4,1
GDTAPIMAX47	maschiatore iMAX ø 4,7
PING15 (3 psc)	pin per guidata ø 1,5
HDH25S	connettore esagono interno 2,5 corto
MDL	cacciavite esagonale 1,25 h. 29
FR15L	fresa D15
CS	mucotomo chirurgia guidata
TRT	estrattore monconi
GD444806	fresa ø 4,4/4,8 x 6,5 mm
GD444808	fresa ø 4,4/4,8 x 8 mm
TWA4	cricchetto completo

Aggiungere i mounter (pagg . 70-71) in funzione della connessione implantare

LIBRERIE IMPLANTARI

PER LA CHIRURGIA GUIDATA

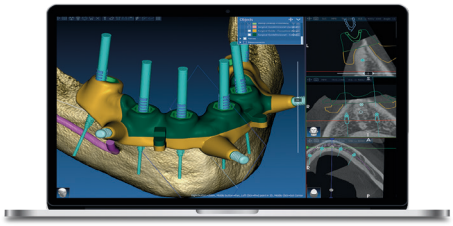

iRES mette **gratuitamente a disposizione** dei suoi clienti **un kit di librerie implantari per la progettazione degli interventi in chirurgia guidata**. **Tutti gli impianti iRes sono presenti in IESS Guide**, il software diagnostico e di chirurgia guidata proposto da **IESS Group** su base **Real Guide**, in grado di rielaborare accuratamente i dati anatomici del paziente e facilitare la definizione del piano di trattamento ideale. Completo e versatile, grazie all'ampia libreria implantare, il posizionamento dell'impianto può essere pianificato tenendo in considerazione, oltre alle caratteristiche anatomiche del sito, anche gli aspetti protesici, al fine di ottenere una riabilitazione funzionale ed estetica.
Le **librerie implantari iRES** sono disponibili sul sito ***https://it.ires.dental/media-kit/*** per i seguenti software:
IESS Guide (RealGuide), Exocad, BlueSky Bio, 3Shape, Implant Studio
Su richiesta, possono essere realizzate le librerie anche per altri software.

PIN Ø 1,5

	PING15
Ti	*26 €*



FRESA Ø 1,5

	FR15L
Inox	*70 €*



FRESA Ø 2,0/2,4

H	
6,5	GD202406
8	GD202408
10	GD202410
11,5	GD202411
13	GD202413
16	GD202416
Inox	*68 €*



FRESA Ø 2,4/2,8

H	
6,5	GD242806
8	GD242808
10	GD242810
11,5	GD242811
13	GD242813
16	GD242816
Inox	*68 €*



FRESA Ø 2,8/3,3

H	
6,5	GD283306
8	GD283308
10	GD283310
11,5	GD283311
13	GD283313
16	GD283316

Inox — *68 €*



FRESA Ø 3,3/3,8

H	
6,5	GD333806
8	GD333808
10	GD333810
11,5	GD333811
13	GD333813
16	GD333816

Inox — *68 €*



FRESA Ø 3,8/4,4

H	
6,5	GD384406
8	GD384408
10	GD384410
11,5	GD384411
13	GD384413
16	GD384416

Inox — *68 €*



FRESA Ø 4,4/4,8

H	
6,5	GD444806
8	GD444808

Inox — *68 €*



FRESA SVASATRICE

ø	
3,3	GDCSD33
3,7	GDCSD37
4,1	GDCSD41
4,7	GDCSD47

Inox — *89 €*



MASCHIATORE IMAX

ø	
3,3	GDTAPIMAX33
3,7	GDTAPIMAX37
4,1	GDTAPIMAX41
4,7	GDTAPIMAX47

Inox — *89 €*



MASCHIATORE S1B

ø	
3,7	GDTAPS1B37
4,1	GDTAPS1B41
4,7	GDTAPS1B47

Inox — *89 €*



BONE PROFILE

	BP

Inox — *68 €*



MUCOTOMO

	CS

Inox — *68 €*



MOUNTER BL

Esagono interno 2,5

	S1B1GSM

Ti — *inclusa S1BRS1* — *58 €*



MOUNTER NBL

Esagono interno 2,1

	S1BN1GSM

Ti — *inclusa S1BRS1* — *58 €*



MOUNTER NHSIC NARROW

Connessione conometrica da 2,1

		NHSICN1GSM
Ti	*inclusa S1BRS1*	*58 €*



MOUNTER EH

Esagono esterno 2,7

		S1EH1GSM
Ti	*inclusa S1EHRS1*	*58 €*



MOUNTER EH 3.3

Esagono esterno 2,4

		S1EHN1GSM
Ti	*inclusa S1EHNRS1*	*58 €*



MOUNTER IMAX MUA DRITTO

		NHSMGSM
Ti	*inclusa NHSMRS1*	*58 €*




BOCCOLA PER PIN

		BPG15
Ti		*15 €*



BOCCOLA

		BG001
PEEK		*15 €*



		BG002
Ti		*15 €*



SEQUENZA **FRESE**



IMPIANTI **Ø 3,3**

	altezza impianto (mm)					
	6	8	10	11,5	13	16
mucotomo CS	•	•	•	•	•	•
bone profile BP	•	•	•	•	•	•
fresa ø 2,0/2,4 L.6,5	•	•	•	•	•	•
fresa ø 2,0/2,4 L.8		•	•	•	•	•
fresa ø 2,0/2,4 L.10			•	•	•	•
fresa ø 2,0/2,4 L.11,5				•	•	•
fresa ø 2,0/2,4 L.13					•	•
fresa ø 2,0/2,4 L.16						•
fresa ø 2,4/2,8 L.6,5	•					
fresa ø 2,4/2,8 L.8		•	•	•	•	•
fresa ø 2,4/2,8 L.10			•			
fresa ø 2,4/2,8 L.11,5				•		
fresa ø 2,4/2,8 L.13					•	•
fresa ø 2,4/2,8 L.16						•
fresa svasatrice ø 3,3	•	•	•	•	•	•
maschiatore ø 3,3	•	•	•	•	•	•

D1 D2-D3 D4

IMPIANTI **Ø 3,7**

	altezza impianto (mm)					
	6	8	10	11,5	13	16
mucotomo CS	•	•	•	•	•	•
bone profile BP	•	•	•	•	•	•
fresa ø 2,0/2,4 L.6,5	•	•	•	•	•	•
fresa ø 2,0/2,4 L.8		•	•	•	•	•
fresa ø 2,0/2,4 L.10			•	•	•	•
fresa ø 2,0/2,4 L.11,5				•	•	•
fresa ø 2,0/2,4 L.13					•	•
fresa ø 2,0/2,4 L.16						•
fresa ø 2,4/2,8 L.6,5	•					
fresa ø 2,4/2,8 L.8		•	•	•	•	•
fresa ø 2,4/2,8 L.10			•			
fresa ø 2,4/2,8 L.11,5				•		
fresa ø 2,4/2,8 L.13					•	•
fresa ø 2,4/2,8 L.16						•
fresa ø 2,8/3,3 L.6,5	•					
fresa ø 2,8/3,3 L.8		•	•	•	•	•
fresa ø 2,8/3,3 L.10			•			
fresa ø 2,8/3,3 L.11,5				•		
fresa ø 2,8/3,3 L.13					•	•
fresa ø 2,8/3,3 L.16						•
fresa svasatrice ø 3,7	•	•	•	•	•	•
maschiatore ø 3,7	•	•	•	•	•	•

D1 D2-D3 D4



IMPIANTI **Ø 4,1**

	altezza impianto (mm)					
	6	8	10	11,5	13	16
mucotomo CS	•	•	•	•	•	•
bone profile BP	•	•	•	•	•	•
fresa ø 2,0/2,4 L.6,5	•	•	•	•	•	•
fresa ø 2,0/2,4 L.8		•	•	•	•	•
fresa ø 2,0/2,4 L.10			•	•	•	•
fresa ø 2,0/2,4 L.11,5				•	•	•
fresa ø 2,0/2,4 L.13					•	•
fresa ø 2,0/2,4 L.16						•
fresa ø 2,4/2,8 L.6,5	•					
fresa ø 2,4/2,8 L.8		•	•	•	•	•
fresa ø 2,4/2,8 L.10			•			
fresa ø 2,4/2,8 L.11.5				•		
fresa ø 2,4/2,8 L.13					•	•
fresa ø 2,4/2,8 L.16						•
fresa ø 2,8/3,3 L.6,5	•					
fresa ø 2,8/3,3 L.8		•	•	•	•	•
fresa ø 2,8/3,3 L.10			•			
fresa ø 2,8/3,3 L.11,5				•		
fresa ø 2,8/3,3 L.13					•	•
fresa ø 2,8/3,3 L.16						•
fresa ø 3,3/3,8 L.6,5	•					
fresa ø 3,3/3,8 L.8		•	•	•	•	•
fresa ø 3,3/3,8 L.10			•			
fresa ø 3,3/3,8 L.11.5				•		
fresa ø 3,3/3,8 L.13					•	•
fresa ø 3,3/3,8 L.16						•
fresa svasatrice ø 4,1	•	•	•	•	•	•
maschiatore ø 4,1	•	•	•	•	•	•

D1 D2-D3 D4

IMPIANTI **Ø 4,7**

	altezza impianto (mm)					
	6	8	10	11,5	13	16
mucotomo CS	•	•	•	•	•	•
bone profile BP	•	•	•	•	•	•
fresa ø 2,0/2,4 L.6,5	•	•	•	•	•	•
fresa ø 2,0/2,4 L.8		•	•	•	•	•
fresa ø 2,0/2,4 L.10			•	•	•	•
fresa ø 2,0/2,4 L.11.5				•	•	•
fresa ø 2,0/2,4 L.13					•	•
fresa ø 2,0/2,4 L.16						•
fresa ø 2,4/2,8 L.6,5	•					
fresa ø 2,4/2,8 L.8		•	•	•	•	•
fresa ø 2,4/2,8 L.10			•			
fresa ø 2,4/2,8 L.11,5				•		
fresa ø 2,4/2,8 L.13					•	•
fresa ø 2,4/2,8 L.16						•
fresa ø 2,8/3,3 L.6,5	•					
fresa ø 2,8/3,3 L.8		•	•	•	•	•
fresa ø 2,8/3,3 L.10			•			
fresa ø 2,8/3,3 L.11,5				•		
fresa ø 2,8/3,3 L.13					•	•
fresa ø 2,8/3,3 L.16						•
fresa ø 3,3/3,8 L.6,5	•					
fresa ø 3,3/3,8 L.8		•	•	•	•	•
fresa ø 3,3/3,8 L.10			•			
fresa ø 3,3/3,8 L.11.5				•		
fresa ø 3,3/3,8 L.13					•	•
fresa ø 3,3/3,8 L.16						•
fresa ø 3,8/4,4 L.6,5	•					
fresa ø 3,8/4,4 L.8		•	•	•	•	•
fresa ø 3,8/4,4 L.10			•			
fresa ø 3,8/4,4 L.11.5				•		
fresa ø 3,8/4,4 L.13					•	•
fresa ø 3,8/4,4 L.16						•
fresa svasatrice ø 4,7	•	•	•	•	•	•
maschiatore ø 4,7	•	•	•	•	•	•

D1 D2-D3 D4

ADVANCED
SOLUZIONI PER LA RIGENERAZIONE

Prodotti dedicati al mantenimento del successo implantare a lungo termine, per ridurre i rischi di complicanze biologiche da diverse prospettive.
Grazie all'esperienza ultratrentennale in ambito odontoiatrico, abbiamo selezionato i partner che assicurano i migliori prodotti di supporto alle crescenti aspettative estetico-funzionali.

SINUS LIFT

Set di strumentazione chirurgica per la preparazione del sito implantare in prossimità della membrana di Schneider. Specifico per l'innovativa tecnica **"crestal sinus lift"** che realizza un'osteotomia crestale controllata con il sollevamento della membrana del seno mascellare con grande semplicità, massima sicurezza e diretto inserimento dell'impianto anche in casi di residui crestali minimi.
Tutti gli strumenti presenti nel kit sono prodotti in acciaio temprato e si caratterizzano per l'inossidabilità e l'elevata resistenza all'usura.
La capacità di taglio delle frese e dei compattatori-espansori è garantita, ad ogni modo si consiglia di tenere sempre sotto controllo il loro profilo tagliente.





EASY BONE MANAGEMENT

Per il rialzo di seno con tecnica EBM

WIDENER

Organizzatore in grado di contenere in modo razionale gli espansori e lo strumentario di movimentazione. Le serigrafie consentono di individuare con immediatezza il widener e gli strumenti da utilizzare.

Gli espansori permettono di ampliare gradualmente la cresta, espandendo l'osso disponibile e riducendo il trauma operatorio, incrementando il volume osseo trasverso in presenza di creste edentule sottili con altezza adeguata.




ALTRI PRODOTTI

Grazie a più di **trent'anni di esperienza** nel settore odontoiatrico, IESS ha selezionato i migliori partner in grado di offrire una **gamma completa di biomateriali**:
dai prodotti di origine eterologa, già ben consolidati nella pratica clinica, a quelli sintetici, per soddisfare pazienti con esigenze specifiche.

RIGENERATIVA

Una gamma completa di biomateriali in grado di coprire tutte le necessità in funzione del caso clinico e della tecnica di rigenerazione adottata.









SUTURE

TOTAL IMPLANT CARE

A completare la gamma, **prodotti speciali** destinati al **mantenimento** e al **ripristino della mucosa orale**, particolarmente indicati per i pazienti a rischio di problemi parodontali e nelle procedure di riabilitazione implantare.



EDUCATION

Un programma formativo teorico-pratico completo, **per tutti i livelli di esperienza**, con corsi annuali o giornalieri tenuti da relatori di fama internazionale sul territorio italiano e all'estero.

Live surgery, **hands on**, **corsi pratici su paziente** trasformano la conoscenza in esperienza; per tutti quei professionisti che desiderano approfondire argomenti specifici della pratica quotidiana, è possibile attivare un **supporto one to one**.









Un programma completo e dinamico per rispondere a tutte le esigenze formative, **per tutto il team odontoiatrico**.

AVVERTENZE E CONDIZIONI DI VENDITA

AVVERTENZE

1. Responsabilità del fabbricante (secondo l'accezione della Direttiva 93/42 CEE e successive modifiche)

Il sistema implanto-protesico IRES è un insieme di dispositivi medici per l'odontoiatria secondo la direttiva, finalizzato alla protesizzazione dentaria del cavo orale di esseri umani. Lo strumentario e la componentistica dedicati allo scopo sono parte integrante e irrinunciabile del sistema e devono quindi essere sempre utilizzati per l'applicazione di impianti dentali iRES, seguendo scrupolosamente le istruzioni e raccomandazioni fornite dal fabbricante (nell'accezione della direttiva). Ogni utilizzo del sistema iRES diverso da quello enunciato o l'impiego di strumenti o componenti diversi da quelli previsti o l'uso di strumentario o componenti non appartenenti al sistema, prodotti da terzi, compromette la funzionalità del sistema iRES e si configura come "uso improprio", sollevando il fabbricante da qualsiasi obbligo o responsabilità. Le informazioni sull'impiego dei prodotti iRES vengono fornite agli utilizzatori per iscritto mediante documentazione cartacea quale istruzioni d'uso, protocolli chirurgici e protesici, mezzi elettronici (audiovisivi e strumenti informatici) o con eventuale dimostrazione pratica (corsi di formazione). Esse corrispondono all'attuale stato dell'arte conosciuto al momento della commercializzazione del prodotto e costituiscono solo un supplemento alla formazione ed esperienza professionale, in quanto non sufficienti per un utilizzo immediato dei sistemi implantari iRES.

2. Responsabilità dell'utilizzatore

Scelta e applicazione del prodotto sono atti compiuti dal professionista nella sua totale autonomia di giudizio e secondo le conoscenze attribuitegli dall'abilitazione alla professione medico-sanitaria e dai successivi aggiornamenti professionali; nessuna responsabilità potrà essere attribuita a IESS Group Srl per danni di qualsiasi natura derivanti da tali atti. La disponibilità di informazioni tecnico-scientifiche di supporto al cliente, infatti, non esonera l'utilizzatore dall'obbligo di verificare personalmente l'idoneità del prodotto allo scopo ed ai procedimenti previsti. L'utilizzatore è, anzi, tenuto ad aggiornarsi continuamente sullo sviluppo e sulle applicazioni dei sistemi implantologici iRES. Ogni utilizzo del sistema diverso da quello enunciato si configura come "uso improprio", sollevando il fabbricante da qualsiasi obbligo o responsabilità. Per utilizzi non espressamente previsti o consigliati, l'utilizzatore dovrà rivolgersi al fabbricante ed ottenere esplicita autorizzazione. La lavorazione, la manipolazione e l'applicazione del prodotto si svolgono al di fuori del controllo del fabbricante e cadono pertanto sotto la responsabilità dell'utilizzatore.

Per l'applicazione endorale dei dispositivi medici, si consiglia di adottare sempre le opportune precauzioni (es. dental dam) al fine di eliminare il rischio di aspirazione accidentale.

3. Garanzia

Il fabbricante, nei termini delle condizioni di vendita, garantisce che i prodotti sono esenti da difetti. IESS Group Srl® riconosce una garanzia di dodici mesi con decorrenza dalla data riportata sul DDT. IESS Group Srl® ha l'obbligo di sostituire la quantità di prodotto riconosciuto difettoso per vizi di fabbricazione o di origine.

La garanzia decade ed è escluso qualsiasi risarcimento da parte del fabbricante nel caso di uso improprio del prodotto, secondo i casi elencati nei paragrafi 1 (responsabilità del fabbricante) e 2 (responsabilità dell'utilizzatore) il reso dei prodotti in garanzia deve essere preventivamente concordato con il fabbricante e accompagnato dalla documentazione richiesta da IESS Group Srl®. Le informazioni sull'esistenza di brevetti, diritti di protezione marchio o di altri beni immateriali non sono giuridicamente vincolanti.

4. Documentazione

Gli opuscoli e le istruzioni dettagliate per l'utilizzo dei sistemi implantologici iRES devono essere richiesti ai nostri agenti commerciali, concessionari di zona o direttamente alla sede. Servizio Clienti:
tel. +39 0432 669191 –
e-mail: servizioclienti@iess.dental - website: www.iess.dental

Le informazioni in essi contenute riportano lo stato dell'arte conosciuto al momento della commercializzazione del prodotto. Ciò non esonera l'utilizzatore dalla responsabilità di verificare personalmente l'idoneità del prodotto allo scopo ed ai procedimenti previsti.

5. Seminari e corsi di formazione

IESS Group Srl® organizza regolarmente seminari e corsi di formazione al fine di permettere agli utilizzatori dei propri prodotti di informarsi ed aggiornarsi sulle caratteristiche e sull'uso appropriato dei sistemi implantari iRES.

6. Identificazione del prodotto

Tutti i prodotti iRES sono identificabili in base al codice di articolo e al lotto riportati sulle etichette accompagnatorie dei dispositivi medici.

7. Confezione di vendita

A meno che non sia indicato diversamente sul catalogo, ogni unità di prodotto identificata dal codice articolo è venduta in confezione singola.

8. Consegna e disponibilità

I prodotti iRES vengono venduti a odontoiatri e laboratori odontotecnici, o per conto di essi, secondo le rispettive competenze. Alcune componenti possono non essere disponibili in determinati Paesi o aree commerciali.

9. Note

Per quanto non riportato nelle presenti avvertenze si rimanda alle specifiche tecniche, condizioni di utilizzo e istruzioni contenute nei materiali informativi iRES.

MODALITÀ DI ORDINAZIONE

1. Nella trasmissione degli ordini fare sempre riferimento al numero di codice dell'articolo.
2. Gli ordini pervenuti entro le ore 12.30 saranno consegnati entro 24-48 ore, salvo disponibilità e zone particolari.

CONDIZIONI DI VENDITA

1. Le presenti condizioni di vendita si intendono accettate da parte del cliente con il conferimento di ogni ordine. Qualsiasi variazione ai termini ivi esposti sarà valida solo se accettata da IESS Group Srl® per iscritto.
2. In relazione alle condizioni di mercato, IESS Group Srl® si riserva di apportare modifiche ai prodotti, ai contenuti dei cataloghi e ai prezzi in qualsiasi momento e senza preavviso.
3. Le spese di trasporto sono a carico del cliente. La merce viaggia a rischio e pericolo del cliente anche se consegnata franco destino.
4. I termini di consegna possono subire delle variazioni. Eventuali disguidi dovuti a inefficienze dello spedizioniere non potranno essere imputati a IESS Group Srl®.
5. IESS Group Srl® si riserva la facoltà di effettuare anche consegne parziali.
6. Il listino applicato è quello in vigore al momento dell'ordine. Il pagamento degli ordini deve avvenire secondo le modalità ed entro i termini convenuti. In caso di inadempienza, IESS Group Srl® si riserva il diritto di variare le condizioni di pagamento per le successive forniture o di ricorrere a ogni altra misura cautelativa o esecutiva per il totale recupero dei propri crediti.
7. Ogni reclamo relativo al mancato rispetto delle condizioni di vendita dovrà essere comunicato per iscritto al Servizio Clienti IESS Group® entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della merce.
8. IESS Group®offre la possibilità di sostituire i prodotti acquistati alle seguenti condizioni:
- prodotti di importo pari o superiore (addebito dell'eventuale differenza a carico del cliente);
- entro 12 mesi dalla data di fatturazione ed entro i 6 mesi antecedenti la data di scadenza riportata in etichetta;
- prodotto residuo integro: confezione originale completa e sigillata;
- prodotto accompagnato da documento di trasporto e copia della fattura di acquisto.

In difetto delle condizioni sopra riportate, il prodotto non verrà ritenuto idoneo e sarà restituito al mittente con addebito delle relative spese spedizione. IESS Group Srl® riconosce il diritto di recesso entro 14 giorni lavorativi dalla data di consegna dela merce.
9. IESS Group Srl® declina ogni responsabilità per eventuali errori commessi involontariamente nella stesura di cataloghi e listini.
10. Per tutto quanto non espressamente previsto dalle condizioni generali di vendita si applicano le disposizioni della legge italiana. Per eventuali controversie è competente il Tribunale di Udine – Italia.

VALIDITÀ DOCUMENTO

La presente documentazione sostituisce le precedenti edizioni.

È assolutamente vietata la riproduzione anche parziale di questi materiali (testi ed illustrazioni) in mancanza di una autorizzazione scritta da parte di IESS Group srl.

note



cod. 05848 - Rev.9 - 07.2026



all for a smile

IESS Group Srl
Via Madonna della Salute 23
33050 Pozzuolo del Friuli (UD) Italy
T +39 0432669191 · info@iess.dental
www.iess.dental